

# Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND

## OWNER'S MANUAL

TOUCHSCREEN MOVEMENT  
& SOUND MONITOR

Model AC701

Pre-programmed  
to monitor sound  
and movement.  
Sensor Pad will alarm  
if no movement  
is detected.




EN  
2

FR  
27

ES  
55

## TABLE OF CONTENTS

 WARNINGS .....	3
AC701 SETUP REQUIREMENTS .....	7
STEP 1 - Charging the Parent Unit (10 hours) .....	8
STEP 2 - Installing the Sensor Pad .....	9
STEP 3 - Setting up the Nursery Unit .....	12
STEP 4 - Turning on your monitor .....	13
STEP 5 - Testing and getting to know your monitor .....	14
STEP 6 - To activate and deactivate additional functions .....	18
Troubleshooting .....	23
Limited warranty .....	25
Technical specifications .....	26
<b>FRANÇAIS</b> .....	27
<b>ESPAÑOL</b> .....	55

## OWNER'S MANUAL

KEEP YOUR OWNER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PLEASE READ THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
ASSEMBLING & USING THE PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT  
IN SERIOUS INJURY OR DEATH OR DAMAGES TO THE PRODUCT.

THE SENSOR PAD FEATURE IS NOT FOR USE WITH ADULTS, CHILDREN OR INFANTS  
OLDER THAN 24 MONTHS.

THE SENSOR PAD IS NOT INTENDED TO BE USED TO DETERMINE IF A CHILD IS OUT  
OF THE CRIB.

### WARNING

Adult assembly required.

Keep small parts away from children when assembling.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products.

If you are not completely satisfied or have any questions,


**United States and Canada:** please contact us at: [angelcare@cdecinc.ca](mailto:angelcare@cdecinc.ca)

**Other countries:** please contact your local distributor.

# ⚠ WARNINGS

**1. THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.** This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. Monitoring of premature babies, or those considered to be at risk, should always be carried out under the supervision of a health professional. This monitor is not intended to be used as a medical monitor.

**2. WARNING Strangulation Hazard – Children have STRANGLED in cords.**



Keep adapter cords out of the reach of children (more than 3 feet [0.9m] away). NEVER use Sensor Pad without the protective cord covering. Check protective cord

covering before each use. Immediately discontinue use of Sensor Pad if protective covering is damaged or broken.

**3. Never use extension cords with AC adapters. ONLY use the AC adapters provided.**

**4. When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, DO NOT touch the exposed end.**

**5. ALWAYS** be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other. Test monitor before first use, periodically and when changing location of the Nursery Unit.

**6. ALWAYS** be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

**7. DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.).



**8. Keep monitor AWAY from heat sources** (such as stoves, radiators, etc.).

**9. ALWAYS** place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat surface in an upright position and allow for proper ventilation. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.

**10.** This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned OFF when not in use. If you experience interference, change the channel on both units.

**11.** This product is NOT a toy. DO NOT allow children to play with it.

**12.** This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product and keep small parts away from children.

**13.** When using the monitor, the room temperature should be between 50°F (10°C) and 104°F (40°C).

## ⚠ BATTERY WARNING

**14.** Use ONLY AAA RECHARGEABLE batteries for the Parent Unit. DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Insert batteries with correct polarity. DO NOT short-circuit supply terminals. ONLY use the recommended batteries or equivalent (volts and size) and the correct adapter. Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are exhausted. Dispose exhausted batteries properly. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are ONLY to be charged under adult supervision. Keep all batteries away from children.

## 15. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**15.1** Read these instructions - All the safety instructions should be read before the product is operated.

**15.2** Keep these instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.

**15.3** Heed all warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

**15.4** Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.

**15.5** Water and moisture - DO NOT use this apparatus near water. For example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet environment or near a swimming pool and the like. Care should be taken so that objects do not fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings.

**15.6** Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse in water any part of the Nursery Unit, the Parent Unit or the Charging Cradle. Clean only with dry cloth.

**15.7** Ventilation - DO NOT block any ventilation openings. Allow for proper ventilation when units are in use. DO NOT cover the Nursery Unit or the Parent Unit with any object such as a blanket. DO NOT place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.

**15.8** Heat sources - DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, TVs or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Heat can damage the case or electrical parts.

**15.9** Power cord protection - Protect the Sensor Pad cord and Adapter's power cord from being walked on or pinched by furniture or other items - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product.

**15.10** Accessories - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

DO NOT place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use ONLY with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

**15.11** Unplug this appliance during lightning storms or when not used for long periods of time.

**15.12** Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery covers) may expose you to dangerous voltage or other hazards.

**15.13** Replacement parts - When replacement parts are required, be sure the replacement parts specified by the manufacturer have the same characteristic as the original part. Unauthorized substitution may result in fire, electric shock or other hazards.

**15.14** Usage - This baby monitor is intended as an aid. It is NOT a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such. Use this appliance ONLY for its intended use as described in this manual.

**15.15** Power Sources - Operate this product only from the type of power source indicated on the type plate of the adaptor. If you are unsure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.


**15.16** Overloading - DO NOT overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

**15.17** Object and Liquid Entry - NEVER push objects of any kind into this product through casing slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. NEVER spill liquid of any kind on the product.

**15.18** Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 7.9" (20 cm) from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**15.19 Power Lines** - An outside antenna system should NOT be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuit, or where it can fall into such power lines or circuits as contact with them may be fatal.

**15.20 WARNING** Strangulation Hazard — Children have STRANGLED in cords.



Keep adapter cords out of the reach of children (more than 3 feet [0.9 m] away). NEVER use Sensor Pad without the protective cord covering. Check protective cord

covering before each use. Immediately discontinue use of Sensor Pad if protective covering is damaged or broken.

**15.21 Interference** - This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned OFF when not in use. If you experience interference, change the channel on both units.

**15.22 Vibration Source** - When the monitor is in use, DO NOT use a crib mobile or other crib accessories that may produce vibrations. Other sources of vibrations may include fans, washing machines, loud music, etc. These sources of vibration may interfere with the performance of your Angelcare® monitor and the alarm will not sound if it continues to detect any movement other than your baby's. Be sure all vibration sources are eliminated before using the monitor.

You may experience false alarms for several reasons. The most common reason is the Nursery Unit has not been turned OFF after you have removed your baby from the crib. Another reason is the Sensor Pad has not been placed under the mattress properly.

Be sure the Sensor Pad is on a flat, firm surface with the printed side facing up. The sensitivity level may also need to be adjusted. Refer to Step 5.1. Always be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

**15.23 Sensor Pad** - If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33 x 33 cm) and 1/4 inch (6 mm) thick. Only use your Angelcare® monitor in a stationary

sleeping environment such as a crib where the Sensor Pad can rest on a completely flat, firm surface.

## 16. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RELATED TO USE OF BATTERIES

**16.1** Use ONLY the type and size of batteries specified in the owner's manual. There is a risk of explosion if batteries are replaced with an incorrect type.

**16.2** Use ONLY AAA rechargeable batteries and/or the AC Adapters provided for the Parent Unit. You must use only rechargeable batteries in the Parent Unit. DO NOT use alkaline batteries or you will severely damage the unit.

**16.3** Charge the batteries for 15 hours prior to first use. Be sure to have the monitor in the OFF position during this period. ONLY use the AC Adapters included with your monitor.

**16.4** DO NOT use these adapters with any other equipments.

**16.5** When unplugging the AC Adapter from the Nursery Unit, be sure it is switched to the OFF position. If it isn't, the unit will revert to battery mode if batteries are installed.

**16.6** DO NOT use rechargeable batteries in the Nursery Unit. Use alkaline batteries ONLY.

**16.7** DO NOT dispose batteries in fire. They may explode. Check with local regulations for possible special disposal instructions.

**16.8** Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen gas and rise in surface temperature.

**16.9** DO NOT attempt to recharge batteries provided with or identified for use with this product that are not intended to be charged. The batteries may leak corrosive electrolyte or explode.

**16.10** DO NOT attempt to rejuvenate the batteries provided with or identified for use with this product by heating them. Sudden release of battery electrolyte may occur, causing burns or irritation to eyes or skin.

**16.11** If and when necessary, the batteries must be replaced with identical new ones or equivalent (volts and size). If a battery to be replaced is connected with other batteries in series, replace the other batteries at the same time as well. DO NOT mix old and new batteries.

**16.12** Reverse polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

**16.13** Remove batteries from this product if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product.

**16.14** Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, it should be replaced immediately using protective gloves.

**16.15** DO NOT store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature areas.

## **FC WARNING**

### **(North America Only)**

**17.1** Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

**17.2 NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules and the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

**17.3** However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**17.4** This device complies with part 15 of the FCC Rules and the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1)** This device may not cause harmful interference, and
- 2)** This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **FCC AND IC REGULATIONS**

### **RF radiation exposure statement**


The Nursery Unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. **Caution:** To maintain the compliance with the FCC's RF exposure guideline, install the Nursery Unit at least 20cm from nearby baby and persons. For body worn operation, this Parent Unit has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Use the supplied belt clip only. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

### **Industry Canada**

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# SETUP REQUIREMENTS

## INCLUDED:



Rechargeable Parent Unit




Nursery Unit




Charging Cradle




Belt Clip

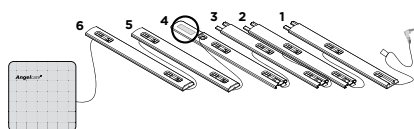

Sensor Pad with pre-installed cord covers



2 AC Adapters



2 AAA Rechargeable Batteries for Parent Unit

## YOU MUST PREPARE:

One hardboard (not included)

Thickness: **1/4" (6 mm)**

Minimum dimensions:

**13" (33 cm) x 13" (33 cm)**

Maximum dimensions:

equal to the mattress size



Hardboard

### IMPORTANT

The hardboard must be larger than the Sensor Pad(s) surface area.

## WHAT YOU WILL NEED (NOT INCLUDED):



2 AA Alkaline Batteries for Nursery Unit




Miniature Philips Screwdriver


## BABY'S ROOM:

### IMPORTANT

Place the crib near a supporting wall and far from air currents. Install the Nursery Unit on a flat, stable surface facing the crib at a distance of at least **3 feet (0.9 meter)**. Make sure to plug the adapter to the socket outlet nearest to the equipment and that is easily accessible.

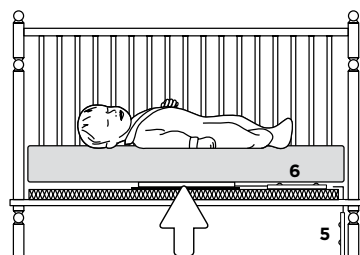


Sensor Pad




### IMPORTANT

Keep at least **3 ft (0.9 m)** apart





## STEP 1 - CHARGING THE PARENT UNIT (10 HOURS)



### WARNING

Never use regular alkaline batteries in the Parent Unit; they may explode.




- 1) Slide the button to unlock and open the battery cover. Insert the Rechargeable Batteries (included) as per picture.
- 2) Connect the AC Adapter to the Parent Unit and into an electrical outlet.
- 3) Charge the unit for **10 continuous hours (prior to first use)**.


### NOTE:

To optimize your battery performance please refer to Battery Guidelines in the Trouble Shooting.

## PARENT UNIT:

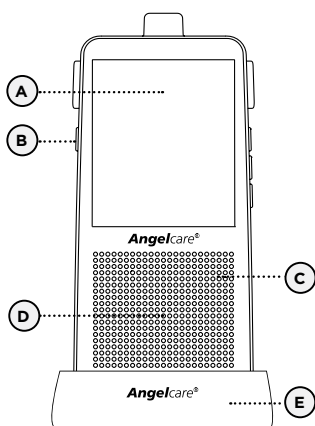


Front View

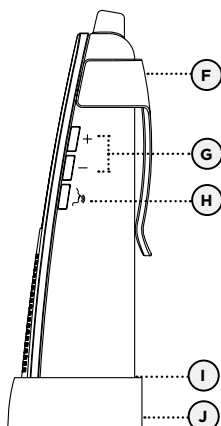

Right Side View

- A) LCD Touchscreen
- B) POWER ON/OFF
- C) Microphone
- D) Speaker
- E) Charging Cradle
- F) Belt Clip
- G) Speaker Volume Buttons
- H) Talk Back Button & °C/°F Selection
- I) Battery Cover (not shown)
- J) AC Adapter Outlet (not shown)



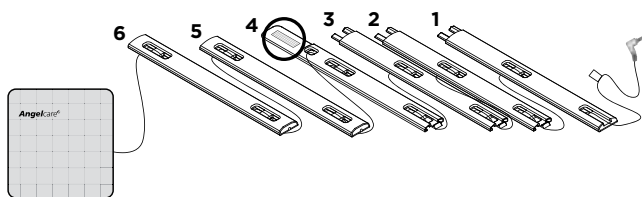

Sensor Pad with pre-installed cord covers

**Cord covers 1,2,3,4:**  
Position on floor

**Cord cover 4:**  
Contains double sided tape to securely install beneath crib leg

**Cord cover 5:**  
Position vertically between mattress support and floor


**Cord cover 6:**  
Place under the mattress

## ⚠ WARNING

### STRANGULATION HAZARD.


Children have STRANGLED in cords.

- Keep adapter cords out of the reach of children (more than 3 feet [0.9 m] away).
- Because of the serious strangulation risk to infants and toddlers, parents and caregivers should never place the Nursery Unit within 3 feet (0.9 meter) of a crib.
- **NEVER** use Sensor Pad without the cord covers. Check cord covers before each use to ensure it is securely placed under the leg of the crib. Discontinue use of Sensor Pad if any cord covers are damaged or broken.
- **NEVER** use extension cords with AC adapters. **ONLY** use the AC adapters provided. This product is not a toy. Never allow children to play with it.




## 2.1 - SELECT A LOCATION FOR THE NURSERY UNIT


Select a location for the Nursery Unit that is at least **3 feet (0.9 meter) away from the crib.**

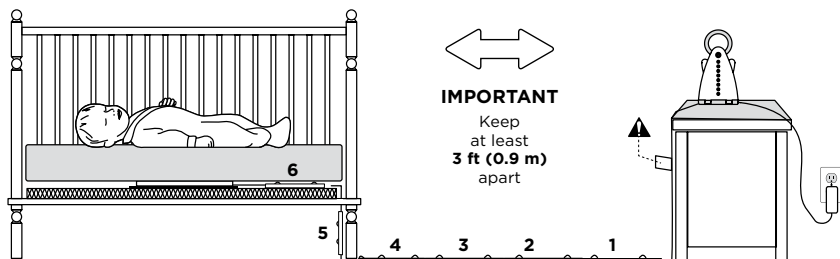

## 2.2 SELECT THE CRIB LEG YOU WILL BE USING TO SECURE THE CORD COVERS

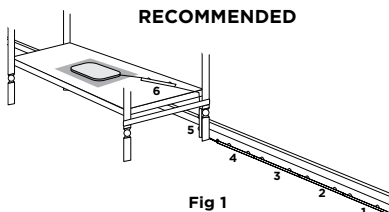


**OR**


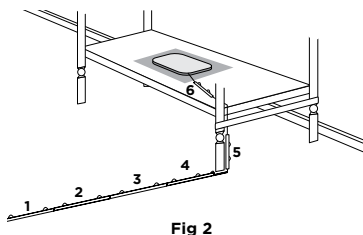






- 1) Use the crib leg by the wall closest to the Nursery Unit (**Fig. 1**). In cases where the Nursery Unit is across the room, use the leg closest to the Nursery Unit to position the covered wire (**Fig. 2**). It is always preferable that the covered cord run along a wall.

## 2.3 - INSTALL THE SENSOR PAD ON THE MATTRESS SUPPORT

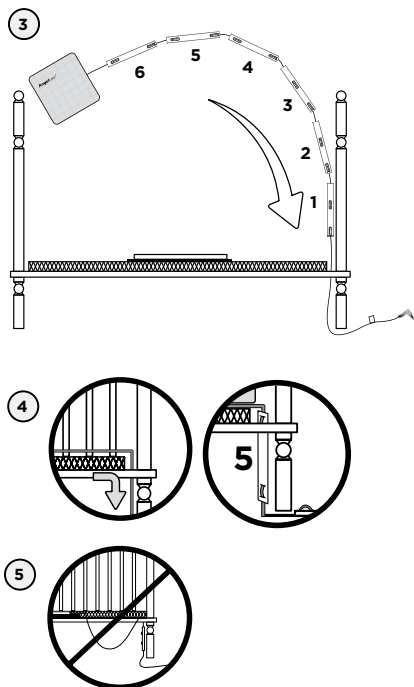

- 1) Remove the mattress from the crib.
- 2) Place the Sensor Pad - printed side up - on top of the **hardboard** at the center of the crib.
- 3) Run the connection pin, warning label and the first 5 cord covers down along the backside of the crib leg, **between the mattress support and the inside edge of the crib**.
- 4) Bring the first 4 cord covers down the floor, and keep the 5<sup>th</sup> cord cover vertically, along the backside of the crib leg, (**between the mattress and the inside edge of the crib**).
- 5) Remove any cord slack to make sure no parts of the cord are loose.

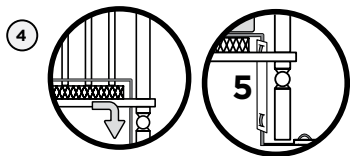


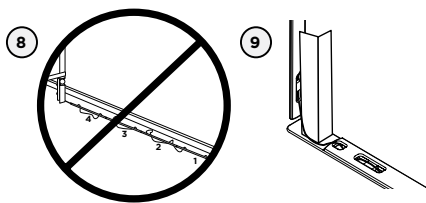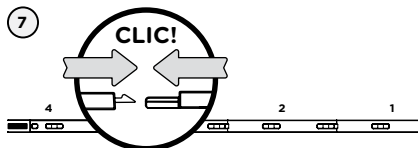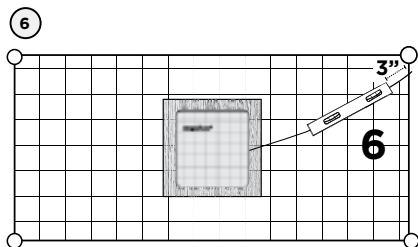

- 6) Place the 6<sup>th</sup> cord cover approximately 3" (8 cm) from the edge of the mattress support.
- 7) Snap together the remaining cord covers that will run along the floor.
- 8) Remove any cord slack to make sure no parts of the cord are loose.
- 9) Peel off the double-sided tape on the 4<sup>th</sup> cord cover and place it securely under the crib leg.
- 10) Install the Nursery Unit on a flat, stable surface facing the crib at a distance of at least 3 ft (0.9 m) and plug the Sensor Pad cord into the Nursery Unit.
- 11) Check to make sure the Sensor Pad has not moved from position.
- 12) Place the mattress back inside the crib.

• The Sensor Pad functions with any size and type of mattress except memory-foam mattresses and hollow frame mattresses.


• The hardboard maintains a constant pressure on the Sensor Pad, enabling it to detect the baby's movements even when the baby is at the edges of the crib.



## **WARNING** **STRANGULATION HAZARD**

- Remove all slack from Sensor Pad Cord.
- When lowering the mattress support as your child grows, slide the vertical Cord Cover (5) upward so it remains approximately in the center between the mattress support and the floor. Slide the Sensor Pad Cord through the Floor Cover to eliminate any additional slack.
- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Discontinue use of the Sensor Pad when child is older than 24 months. Remove Sensor Pad from crib and store for future use.
- **BEFORE FIRST TIME USE:** To test that the unit is ready for use, refer to instruction manual on how to test that the installation has been done


### STEP 3 - SETTING UP THE NURSERY UNIT




- 1) Unscrew the battery cover and insert 2 AA Alkaline Batteries (not included).
- 2) Place the Nursery Unit at a **minimum of 3 ft. (0.9 m)** away from the crib.
- 3) Connect the AC Adapter to the Nursery Unit and plug into an electrical outlet.

#### NOTE:


The batteries maintain power supply in case of power outage.

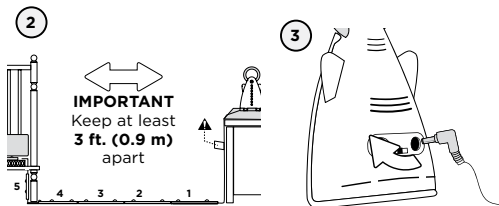

#### NURSERY UNIT:

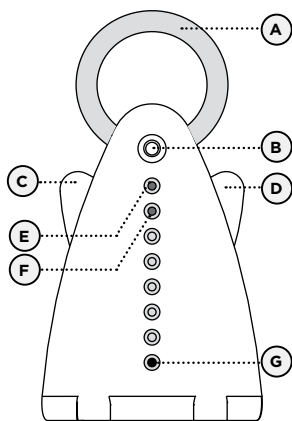


Front View

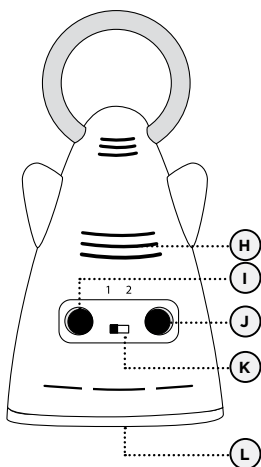

Rear View

- A) Night Light
- B) Hold/Pager Button
- C) **POWER ON/OFF** (Left 'Wing')
- D) Night Light ON/OFF (Right 'Wing')
- E) Power Indicator (green)  
Low Battery Indicator (red)  
Hold indicator (green flashing)
- F) Movement Indicator (green)  
Alarm Indicator (red)
- G) Microphone
- H) Speaker
- I) Sensor Pad Outlet
- J) AC Adapter Outlet
- K) Nursery Unit Switch  
Mode 1 - Standard Mode  
Mode 2 - Movement Only
- L) Battery Cover (not shown)

## STEP 4 - TURNING ON YOUR MONITOR

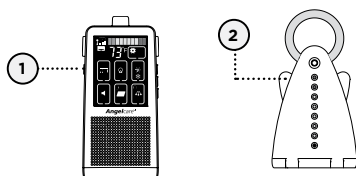


- 1) Press the Parent Unit **ON/OFF** button to open and display normal mode.
- 2) Push and hold the Nursery Unit **left 'wing'** button for 2 seconds.

The LCD monitor has 30 seconds timeout to go to power saving mode (dimmer illumination). Press any keys to wake up.



When the Parent Unit is turned **ON** and the Nursery Unit is **OFF**, the Parent Unit will be searching for connection with the Nursery Unit. The **Connection** icon will scan as the following cycle.



If there is a lost connection between the 2 units (refer to troubleshooting):

- The **Out-of-Range** icon will appear on the screen and the Parent Unit will beep.

## IMPORTANT ICONS



**Temperature icon:**  
Indicates room temperature

**Battery Level icon:**  
Indicates battery level



Empty



1/3 Full



2/3 Full



Full



**Sound icon:** Indicates sound is active



**Sensor Pad icon:** Indicates the Movement Sensor is active



**Pendulum icon:** Indicates the 'TIC' function is active



**Level Bar:** Indicates sound level from Nursery Unit.

**Connection icon:** Indicates the connection quality between the Parent Unit and Nursery Unit.



**Settings Icons:** Access to settings



**VOX icon:** Indicates Vox function is active (Voice activation)



**ECO icon:** Indicates ECO function is active



**Temperature Alarm icon:** Indicates Temperature Alarm is active



Good connection



Fair connection




Poor connection



Out-of-Range

## STEP 5 - TESTING AND GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

The Angelcare® monitor can be used with the pre-program factory settings or you can also customise your settings to your preference.



**NOTE:** All changes and adjustments made in the **Settings** mode will not be activated unless you confirm them by pressing the **Return** icon. A long beep will confirm your modification.

### IMPORTANT

When in **Settings** mode, sound transmission between Parent and Nursery Units will be temporarily deactivated. **ONLY** the **Movement alarm** will remain active (if function is activated).

## 5.1 - SENSOR PAD

### TO ACTIVATE THE SENSOR PAD:




Press **Sensor Pad** icon to **activate** or **deactivate** movement mode.



When the **Movement** mode is **OFF** the '**TIC**' mode is automatically set **OFF**. This allows you to detect the **baby's sounds ONLY**.

### TO TEST THE SENSOR PAD:

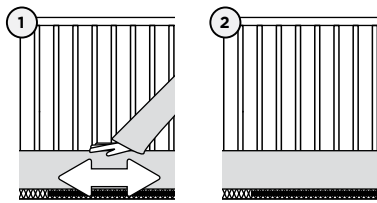

- 1) Move your hand lightly on the mattress.
- 2) Remove your hand from the mattress. After 15 seconds you will hear a '**TIC**' pre-alarm sound, and 5 seconds later the **Movement Alarm** will trigger.
- 3) Repeat by moving your hand lightly in all four corners of the mattress. Ensure the **Nursery Unit Movement Indicator** is still flashing.




### MOVEMENT ALARM

- Alarm activates when no movement is detected by Sensor Pad for 20 seconds.
- Both the Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud warning sound.
- **Movement Alarm** icon will show on the LCD screen.

### IF THE ALARM DOES NOT SOUND

- Avoid contact with crib while Sensor Pad is in operation.
- Place crib near a supporting wall.
- Adjust the Sensor Pad sensitivity level.

## TO STOP THE ALARM



Place your hand back on the mattress.

# OR


Press any key on the Parent Unit to put on **Hold** (see **Step 6.5**)





# OR

Press Nursery Unit's **Hold** button (see **Step 6.5**)

Hold down **left 'wing'** button for two seconds to turn **OFF** the Unit



## TO ADJUST THE SENSOR PAD SENSITIVITY LEVEL:



Level 1	L1
Level 2	L2
Level 3	L3
Level 4	L4
Level 5	L5

1) Press the **Settings** icon to access setting mode.

2) Press **Movement Sensitivity icon**.



3) Use the (+) or (-) on the right side of the Parent Unit to choose the desired sensitivity level (1 to 5)

**OR**

Press the movement sensitivity icon to choose the desired sensitivity level. L1 being the least sensitive and L5 the most sensitive.

4) Press **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.

### NOTE:

If you are receiving false alarms, adjust the sensitivity level.

### NOTE:

Whilst in **Setting** mode, if after 30 seconds no adjustments are made, the unit will go back to normal and no update will be done.

## TO ACTIVATE THE TIC FUNCTION:

This allows you to hear a '**TIC**' sound with baby's movements (when the movement detection is **ON**)



### NOTE:

When the Movement Mode is set to OFF, the TIC Mode is automatically set to OFF.

Press **TIC** icon to **activate** or **deactivate** the '**TIC**' function.



ON



OFF

If the **TIC** icon is activated a regular **TIC** sound will emit from Parent Unit.

### NOTE:

When using **ECO** mode, the **TIC** function shuts **OFF**.

## IMPORTANT

- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Once you are finished using the Sensor Pad, please remove it from the baby's crib and store it away.


## 5.2 - SOUND

### TO ADJUST THE SOUND:

Press (+) or (-) buttons to adjust the volume level.


#### NOTE:

At level **L0** the level bar will still appear on the screen and the icon will blink. If you press the blinking **Sound** icon again, it automatically activates the **Mute** function. The Bar will disappear and a cross will appear in the icon screen. To **DEACTIVATE**, press the **Sound** icon again. (Refer to **Step 6.6** for more information on **Mute** mode).




Level 0	<b>L0</b>
Level 1	<b>L1</b>
Level 2	<b>L2</b>
Level 3	<b>L3</b>
Level 4	<b>L4</b>
Level 5	<b>L5</b>

### TO LOWER VOLUME LEVEL TO L0



Press the **(-)** button to select the **L0** level (see **Step 6.6**)

### PUT IN TALK BACK MODE



Press and hold the **Talk Back** button to speak to your baby.

### TO TEST THE SOUND:

Ask someone to speak into the Nursery Unit or place the unit near a radio to ensure that sound is being picked up.

#### IMPORTANT

To avoid feedback (whistling), keep both units at least 10 ft (3 m) apart.

### IF YOU HEAR NO SOUND:

- Check that both units are switched **ON**.
- Check that both units are plugged into a working electrical outlet.
- Check the batteries in both units (replace or recharge them as necessary per unit).
- Bring the Parent Unit closer to the Nursery Unit.

## 5.3 - BATTERIES


### HOW TO CHECK THE BATTERIES:

Unplug the AC Adapters from both units.

- If the green light on the Nursery Unit does not show, replace the batteries.
- If the Parent Unit and its screen do not light up, recharge the batteries.

### HOW TO CHARGE THE BATTERIES IN THE PARENT UNIT:

Leave the Parent Unit in the Charging Cradle to fully charge the unit. Although the batteries at 1/3 capacity works normally, we recommend that you fully recharge them.



#### PARENT UNIT BATTERY ALARM

- Alarm activates when batteries need to be recharged.
- Parent Unit will emit a beep sound every 20 seconds.
- **Battery** icon will flash on Parent Unit screen.



# YOU ARE NOW READY TO USE YOUR MONITOR

The Angelcare® monitor can be used with the pre-program factory settings or you can also customise your settings to your preference.

## DEFAULT SETTINGS



**Sound Mode:** ON  
**Speaker Volume:** Level 3 (of 5)



**Movement Mode:** ON  
**Sensor Pad Sensitivity:** Level 3 (of 5)  
**TIC:** OFF



**Temperature Alarm:** OFF  
**Temperature Alarm Settings:**  
High Temperature Limit\*: 86°F / 30°C  
Low Temperature Limit\*: 66°F / 19°C

**VOX**

**VOX Mode:** OFF  
**VOX Level:** Level 2 (of 4)


**ECO**

**ECO Mode:** OFF



**Alarm Mode:** Sound alarm only

\* High/Low Temperature Setting  
preset values might be different  
for various countries.

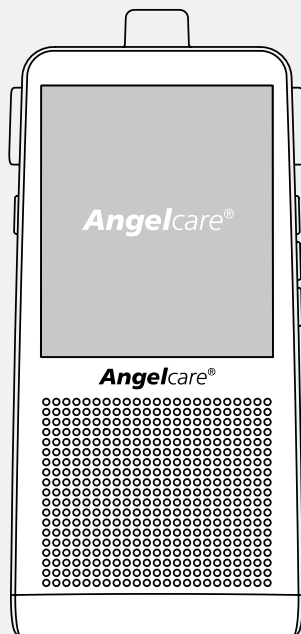

## NOTE:


By doing the re-connection procedure you will reset the monitoring system back to original presets.

## IMPORTANT

- Test your monitor before first use.
- Test your monitor regularly to ensure it is functioning correctly.
- Test your monitor every time you move the Sensor Pad to a different place.


## MULTIFUNCTIONAL

The Angelcare® monitor is multifunctional. It can be use in different combinations according to your needs.




### SOUND & MOVEMENT:

Allows you to detect the baby's **MOVEMENT & SOUND** while using both Parent Unit and Sensor Pad.




Slide the Nursery Unit Connecting switch to **1** to detect sound and movement.




### MOVEMENT ONLY:

Allows you to detect the baby's **MOVEMENT ONLY** without the Parent Unit. This combination can be useful when the baby is in the same room as the parents.




Slide the Nursery Unit Connecting switch to **2** to detect **MOVEMENT ONLY**. If the Parent Unit is turned **ON**, the Parent Unit will only display the **Out-of-Range** icon.



### SOUND ONLY:

Allows you to detect the baby's **SOUND ONLY** without the Sensor Pad. This combination can be useful if you don't want to use the Sensor Pad or if your baby is older than 24 months (maximum age to use the Sensor Pad).




Slide the Nursery Unit Connecting switch to **1** to detect **SOUND ONLY** (Sensor Pad function needs to be deactivated on the Parent Unit then unplugged from the Nursery Unit).

### NOTE:

To safely store just make sure to remove the Sensor Pad and cords from the crib – disconnect sensor cord plug from the nursery unit and safely store away in box for future use.

The Angelcare® monitor can be used with the pre-program factory settings or you can also customise your settings to your preference.



**NOTE:** All changes and adjustments made in the **Settings** mode will not be activated unless you confirm them by pressing the **Return** icon. A long beep will confirm your modification.


### IMPORTANT

When in **Settings** mode, the sound transmission between the Parent and the Nursery Unit will be temporarily deactivated. **ONLY** the **Movement Alarm** will remain active (if function is already activated).

## 6.1 - VOICE ACTIVATION (VOX) OR CONTINUOUS SOUND MODE

Allows you to select your option on how you monitor sound:

**VOX** (voice activation picks up sound based on the selected sensitivity level settings) or **Continuous** (sound monitoring is continuously on, picking up all sounds).



- 1) Press the **VOX** icon to **activate** or **deactivate** the VOX function.





### NOTE:

By deactivating **VOX**, the **Continuous sound** setting is **ON**.

### TO ADJUST THE VOX SENSITIVITY:

Allows you to determine the sound level needed to trigger sound transmission to the Parent Unit.

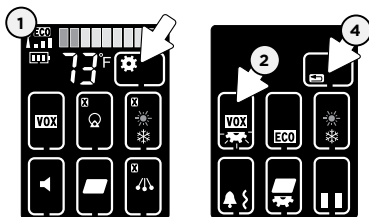

Level 1 L1  
Level 2 L2  
Level 3 L3  
Level 4 L4

- 1) Press the **Settings** icon to access setting mode.
- 2) Press the **VOX Sensitivity** icon.  
The icon will blink.
- 3) Use the **(+)** or **(-)** on the right side of the Parent Unit to choose the desired sensitivity level (**1** to **4**)  
**OR**  
Press **VOX Sensitivity** icon to choose the desired level.
- 4) Press **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.


### NOTE:

When using **ECO** mode, the monitor will automatically switch to **VOX** setting.

## 6.2 - ECO MODE

Allows you to reduce the electro-smog and save battery life. Please note that while in **ECO** mode the range will be reduced.

### TO ACTIVATE ECO MODE:

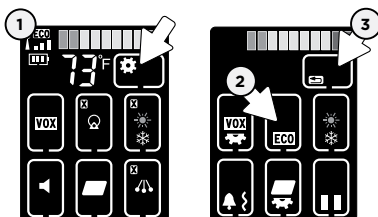

- 1) Press the **Settings** icon to access the setting mode.
- 2) Press the **ECO** icon to **activate** or **deactivate** the **ECO** function.




- 3) Press the **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.



The **ECO** icon will appear next to the **Connection** icon when the function is active.

## 6.3 - TEMPERATURE CONTROL

### TO CHANGE THE MEASUREMENT UNIT:

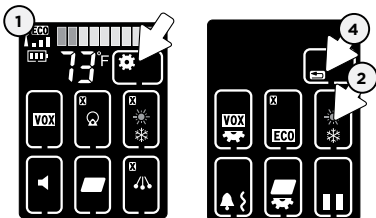

- 1) Press the **Settings** icon to access setting mode.
- 2) Press the **Temperature Settings** Icon.
- 3) Press the **Talk button** on Parent Unit to change from **Celsius** to **Fahrenheit**.



- 4) Press the **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.


### TO ACTIVATE THE TEMPERATURE ALARM:



- 1) Press the **Temperature Alarm** icon to **activate** or **deactivate** the high and low temperature alarm.



### TO SET TEMPERATURE RANGE:

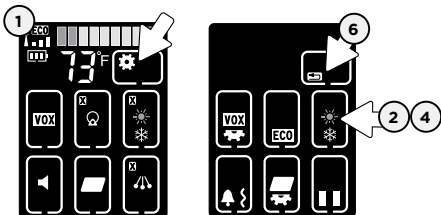

- 1) Press the **Settings** icon to access setting mode.
- 2) Press the **Temperature Alarm** icon.
- 3) **High Temperature** (SUN) icon will blink, press **(+)** or **(-)** to set the **high temperature alarm** (22 to 35°C / 72 to 95°F).
- 4) Press the **Temperature Alarm** icon again.
- 5) **Low Temperature** (SNOWFLAKE) icon will blink, press **(+)** or **(-)** to set **low temperature alarm** (5 to 19°C / 41 to 66° F).
- 6) Press the **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.




#### TEMPERATURE ALARM

- Alarm activates when the temperature reaches a maximum or minimum set temperature.
- Parent Unit will emit 3 consecutive beeps and/or vibrate every 5 seconds depending on the type of alarm chosen.
- **Temperature Alarm** icon will show on LCD screen with the **Low/High** icon blinking.



## 6.4 - ALARM

Allows you to select your preferred alarm mode for the Parent Unit.

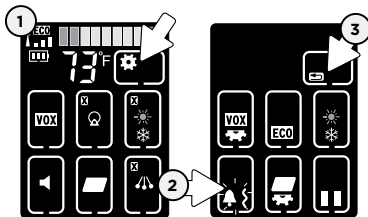

- 1) Press the **Setting** icon to access setting mode.
- 2) Press the **Alarm** icon, current alarm mode icon will blink. Then press again to select the alarm mode as the display changes for various modes.
- 3) Press the **Return** icon to confirm your choice and return to normal screen.



Sound alarm only



Sound alarm and vibration



Vibration only:

When the movement alarm is triggered, the Parent Unit will vibrate and a sound alarm will be heard on the Nursery Unit.


When the Parent Unit is on the charger, the sound alarm will replace the vibration mode.

### IMPORTANT


When in setting mode no sound or alarms will transmit to the Parent Unit, except the movement alarm (if this function was already activated).

## 6.5 - HOLD

Allows you to put your Angelcare Monitor on **HOLD**.

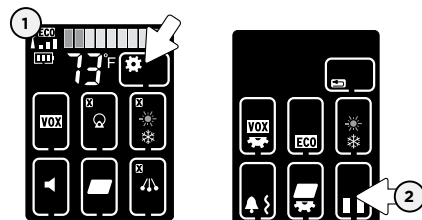

- 1) Press the **Settings** icon to access the setting mode.
- 2) Press the **Hold** icon  
**OR**  
Press the **Nursery Unit Hold button** for 4 seconds.
- 3) Press the **Hold** icon for 4 seconds or the **Nursery Unit Hold button** again to return to normal operation.



### NOTE:

When on **HOLD**, the Nursery Unit Power Light will blink. The Parent Unit will emit beeps and/or vibrate every 20 seconds to remind you that monitor is on hold, depending on the type of alarm chosen.

### IMPORTANT

When your monitor is on **HOLD**, the movement feature and Movement alarm are disabled.

## 6.6 - MUTE


Allows you to activate the MUTE function.

### TO ACTIVATE MUTE:

Press the Sound Icon.

### TO DEACTIVATE MUTE:

Press the Sound Icon to deactivate.

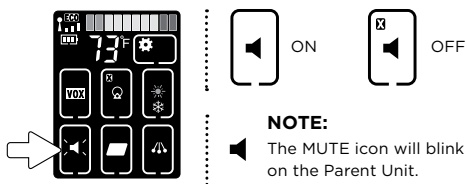


## 6.7 - NIGHT LIGHT

Allows you to use your monitor as a night light.

### TO ACTIVATE THE LIGHT:

Push the **right 'wing'** of the Nursery Unit or press the **Night Light** icon on the Parent Unit to select light level.

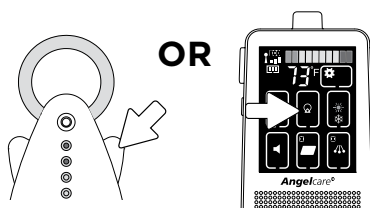

### NOTE:

The Night Light function will be disabled if the Nursery Unit is in battery mode.



## 6.8 - PAGER

Allows you to locate the Parent Unit.

### TO LOCATE PARENT UNIT:

Press and release the **Nursery Unit Pager** button. The Parent Unit will emit a paging sound for one minute.




### TO STOP THE PAGING SOUND:



Press the **Parent Unit screen** or any buttons

OR

Press the **Nursery Unit's Page** button




## TAKING CARE OF YOUR RECHARGEABLE BATTERIES

- Ensure that you fully charge your batteries for 10 hours before their first use.
- To maintain maximum battery life it is recommended that you fully discharge your batteries periodically. Battery performance can be diminished by leaving the batteries constantly charging on the charging cradle. If your parent unit is not in use, please turn it **OFF**.
- Inadequate battery power can impair the performance of your monitor. If you are not happy with the performance of your Parent Unit/Monitor please replace the rechargeable batteries (2 x NiMH Rechargeable Batteries).
- It is advisable to change the batteries every 6 months.

## LOSS OF CONNECTIVITY

In the case of loss of connectivity, the first step is to bring the Parent Unit and Nursery Unit closer together and make sure that both units are **ON** to restore the connection. If there is still no connection and no **Out-of-range** warning after the above has been done, then and only then should the re-connection procedure below be done.

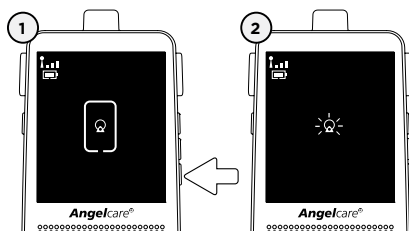

### Re-connection procedure:


- 1) Turn **ON** the Parent Unit and hold the **Talk** button down for 2 seconds until the Nursery Unit icon shows at the center of the screen.
- 2) By pressing the **Nursery Unit** Icon button the Parent Unit will be set in to **Connectivity** mode (the icon will flash).

After 1 minute of non-operation, the Parent Unit will exit the **Connectivity** mode and you will need to start this process again.

- 3) Press the **Power** button to turn **ON** the Nursery Unit. The Power LED will light.
- 4) Then press the **Power** button 4 times within 30 seconds. The Power LED will blink. The connection procedure should be completed within 10 seconds.
- 5) When the Parent Unit and Nursery Unit are connected, **H1** (or **H2**) will be displayed on the Parent Unit and then be followed by the normal mode screen.



### NOTE:

By doing the re-connection procedure you will reset the monitoring system back to original presets.



### NOTE:

Make sure the Nursery Unit Connecting switch on the back of the unit is in the position 1.



## FALSE ALARMS

.....

- Turn **OFF** the Nursery Unit.
- Verify the connection between Sensor Pad and Nursery Unit. Unplug and reconnect the cord.
- Make sure there is no bedding between mattress and Sensor Pad.
- If the crib has a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33x33 cm) and 1/4" (6 mm) thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensor Pad Sensitivity level may need to be adjusted, refer to **Step 5.1**.

## ALARM WILL NOT SOUND

.....

- Avoid contact with the crib when the monitor is **ON**.
- Place crib near a solid supporting wall to avoid Sensor Pad from detecting movement from outside the crib.
- You may need to decrease the sensitivity, refer to **Step 5.1**.
- Turn **OFF** crib mobile, fans, loud music or anything else that may cause vibration.

## NO SOUND IS BEING TRANSMITTED

.....

- Ensure that both units are switched **ON**.
- If there is no power to any unit check/replace the batteries, recharge the Parent Unit & check the AC Adaptors are working. Change electrical outlets if required.
- Check on the Parent Unit screen to see if the monitor is in **MUTE** mode instead of **ON** mode. Refer to **Step 6.6** and increase volume level.
- Bring the Parent Unit and Nursery Unit closer together.

## NURSERY UNIT POWER ON INDICATOR (GREEN LIGHT) DOES NOT LIGHT UP

.....

- Check the connections or change to another electrical outlet.
- Push and hold the left 'wing' for 2 seconds to turn the Nursery Unit **ON**.

## WEAK RECEPTION

.....

- Bring the units closer together.
- Change the position of one or both units.
- Place the units on a flat surface away from baby's reach.
- Replace the batteries or recharge the Parent Unit.

## STATIC, DISTORTION, INTERFERENCES (FROM OTHER MONITORS, WIRELESS PHONES, WALKIE-TALKIES, ETC...)

.....

- Rotate the Parent Unit or move it away from source of interference.



## FEEDBACK (LOUD NOISES EMITTED FROM THE PARENT UNIT)

- Move the units farther apart (at least 10 feet (3 meters) apart).
- Decrease volume on the Parent Unit.

## THE PARENT UNIT SCREEN IS BLACK (PARENT UNIT IS OFF)

- Turn the Parent Unit back ON by pushing and holding the Power button.
- Replace the batteries or recharge the Parent Unit.

## LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® rechargeable TOUCHSCREEN MOVEMENT & SOUND MONITOR (model AC701) is free from any material and workmanship defects, for a period of one (1) year (Rechargeable batteries not included) from the date of the original purchase. If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions within the one year period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your distributor.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

**This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.**

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare®-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare®.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

### IMPORTANT!

This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

#### REGISTER ANGELCARE PRODUCTS

Register your Angelcare® monitor and other Angelcare® products on our website:  
[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)

ANGELCARE MONITORS INC.  
 9975, avenue De Catania, Local B  
 Brossard, Québec, Canada  
 J4Z 3V6

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Range:

Open field (Open area without obstructions): up to 820 feet (250 meters).

### Power Supply:

2 AA Alkaline batteries (not included) or 100-240V AC/5VDC Adapter for Nursery Unit.

2 AAA rechargeable batteries and 100-240V AC/5VDC adapter for Charging Base for the Parent Unit.

**Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The included Batteries are 2 AAA NIMH rechargeable batteries, manufactured by GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) or by HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). **They may only be replaced by 2 AAA NIMH rechargeable batteries.**

### Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (NI-CD, NIMH, etc) batteries.



## PROTECT THE ENVIRONMENT

This electronic equipment contains reusable material and must not be disposed with domestic waste. Please take it to a collecting point for electric and electronic equipment (ask your local authorities for details).

## ErP COMPLIANCE

SOUTH AFRICA-BRAZIL-ECUADOR-EUROPEAN UNION-UK

Use only Angelcare® Brand power supply - model number: T05005V001 / T05005B001

GERMANY

Use only Angelcare® Brand power supply - model number: T05005F002

AUSTRALIA

Use only Angelcare® brand power supply - model number: T05005S002

NORTH AMERICA

Use only Angelcare® brand power supply - model number: T05005U002

## Transmission:

Data transmission between the Parent Unit and Nursery Unit is made on a frequency between 1880 and 1920 Mhz (the exact frequency band varies among countries).

Hereby, Angelcare Monitors Inc, declares this baby monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The EU declaration of conformity can be obtained through your local distributor. Please refer to address in the manual.

# Angelcare®

PARA SU TRANQUILIDAD

## MANUAL DEL PROPIETARIO


MONITOR DE MOVIMIENTOS  
Y SONIDOS CON PANTALLA TACTIL

Modelo AC701

Preprogramado para  
supervisar sonidos y  
movimientos.  
Si no detecta ningún  
movimiento, el detector  
de movimientos emite  
una alarma.



## ÍNDICE

 ADVERTENCIAS.....	57
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN AC701.....	62
PASO 1 - Cargue la unidad para los padres (10 horas) .....	63
PASO 2 - Instalación del detector de movimientos.....	64
PASO 3 - Instalación de la unidad del bebé.....	67
PASO 4 - Encendido del monitor.....	68
PASO 5 - Prueba y conocimiento del monitor .....	69
PASO 6 - Activación y desactivación de funciones adicionales.....	73
Resolución de problemas.....	78
Garantía limitada.....	80
Especificaciones técnicas .....	81

## MANUAL DEL PROPIETARIO

GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA FUTURAS CONSULTAS.

LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR EL PRODUCTO.

NO RESPETAR LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES (INCLUSO LA MUERTE), O DAÑOS AL PRODUCTO.

EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS NO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE CON ADULTOS, NIÑOS O LACTANTES DE MÁS DE 24 MESES.

EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO PARA DETERMINAR SI EL NIÑO ESTÁ AFUERA DE LA CUNA.

## ADVERTENCIA

Es necesario que un adulto realice el montaje.

Cuando realice el montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

En Angelcare®, respaldamos todos nuestros productos.

Si no está completamente satisfecho o si tiene preguntas, contáctanos;


**Estados Unidos y Canadá:** comuníquese con nosotros a través del correo electrónico: [anglecare@cdecinc.ca](mailto:anglecare@cdecinc.ca);

**los demás países:** contacte su distribuidor local.

# ⚠ ADVERTENCIAS

**1. ESTE PRODUCTO NO PUEDE REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN RESPONSABLE DE UN ADULTO.** Este producto está diseñado para ayudar en la supervisión de su hijo. Aun cuando use el monitor, debe proporcionar la supervisión necesaria para la continua seguridad de su hijo. La supervisión de bebés prematuros o aquellos que se consideran en riesgo, siempre debe llevarse a cabo bajo el seguimiento de un profesional de la salud. Este monitor no está destinado a un uso médico.

**2. ADVERTENCIA Peligro de estrangulación** — Ha habido casos de niños que se han ESTRANGULADO. Mantenga los cables de los adaptadores fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]). NUNCA use el detector de movimientos sin la cobertura de protección del cable.



Verifique la cobertura de protección antes de cada uso. Si la cobertura de protección se encuentra dañada o rota, suspenda inmediatamente el uso del detector de movimientos.

**3. Nunca utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice ÚNICAMENTE los adaptadores de CA suministrados.**

**4. Cuando el adaptador de CA está enchufado a un tomacorriente, NO toque el extremo expuesto.**

**5. Compruebe SIEMPRE de que tanto el transmisor como el receptor funcionan correctamente y ambos están dentro del radio de alcance del otro. Pruebe el monitor antes del primer uso, periódicamente y al cambiar la ubicación de la unidad del bebé.**

**6. Compruebe SIEMPRE el estado del bebé inmediatamente cuando suene la alarma.**

**7. NO utilice el monitor junto al agua (por ejemplo, cerca de la bañera, del lavabo, etc.).**



**8. Mantenga el monitor ALEJADO de fuentes de calor (como cocinas, radiadores, etc.).**

**9. SIEMPRE coloque tanto la unidad del bebé como la unidad para los padres sobre una superficie plana, en posición vertical que permite la ventilación adecuada. NO coloque el producto sobre sofás, cojines, camas, etc., que podrían impedir la ventilación.**

**10. Este monitor utiliza ondas públicas de radio para transmitir señales. La unidad para los padres puede captar señales o interferencias de otros monitores de bebés de su zona. Las señales de su monitor hasta pueden ser captadas en otras viviendas. Para proteger su esfera privada, asegúrese de que ambas unidades estén APAGADAS (OFF) cuando no se encuentran en uso. Si capta interferencias, cambie el canal de ambas unidades.**

**11. Este producto NO es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.**

**12. Este producto contiene piezas pequeñas. Es necesario que un adulto realice el montaje. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.**

**13. Utilice y almacene el monitor a una temperatura entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F).**

## ⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

**14. Utilice SOLO baterías AAA RECARGABLES tipo AAA en la unidad para los padres. NO mezcle baterías nuevas y usadas. NO mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables. Inserte las baterías con la polaridad correcta. NO provoque**

un cortocircuito en los terminales de alimentación. Utilice ÚNICAMENTE las baterías recomendadas o equivalentes (voltios y tamaño) y el adaptador correcto. Quite las baterías cuando el producto se vaya a guardar durante largos periodos de tiempo o cuando las baterías se hayan agotado. Elimine las baterías agotadas debidamente. NO recargue las baterías no recargables. Las baterías recargables SOLO se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

## **15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES EL PRODUCTO**

**15.1** Lea estas instrucciones: debe leer todas las instrucciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el producto.

**15.2** Guarde estas instrucciones. Debe conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para una futura consulta.

**15.3** Observe todas las advertencias: se deben respetar todas las advertencias sobre el producto y las instrucciones de funcionamiento.

**15.4** Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

**15.5** Agua y humedad: NO utilice este dispositivo junto al agua. Como por ejemplo, junto a una bañera, lavabo, fregadero, barreño, en un entorno húmedo o junto a una piscina o lugares similares. EVITE que las unidades sufran golpes y que se derramen líquidos sobre las aberturas de la unidad o el detector de movimientos.

**15.6** Limpieza: desconecte todas las unidades antes de su limpieza. NO sumerja en agua ninguna pieza de las unidades del bebé o para los padres y la base de carga. Limpie solo con un paño seco.

**15.7** Ventilación: NO bloquee las aberturas de ventilación. Asegure una ventilación correcta cuando las unidades estén en funcionamiento. NO cubra las unidades del bebé o para los padres con ningún objeto, como por ejemplo una manta. NO las guarde en cajones o lugares donde se pudiera amortiguar el sonido o el flujo normal de aire se pudiera ver interrumpido.

**15.8** Fuentes de calor: NO las coloque junto a fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas, televisores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que emitan calor. El calor puede dañar la carcasa o las piezas eléctricas.

**15.9** Protección de los cables de alimentación: proteja el cable del detector de movimientos y el cable de alimentación del adaptador para evitar que los pisen o los aprisionen con muebles u otros objetos. Los cables eléctricos deben colocarse de modo que no haya riesgos de pisarlos ni aplastarlos o apretarlos con algún objeto; preste especial atención a los cables y enchufes, a los receptáculos y a los puntos por donde salen del producto.

**15.10** Accesorios. Solo use dispositivos/ accesorios especificados por el fabricante. NO coloque este producto sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestables. El producto podría caerse y dañarse, así como causar lesiones graves a niños o adultos. Use ÚNICAMENTE con un carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cada vez que se arme el producto deben seguirse las instrucciones del fabricante.

**15.11** Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos.

**15.12** Mantenimiento: NO intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las tapas (excepto la tapas del compartimiento de batería) puede exponerse a voltajes peligrosos u otros peligros.

**15.13** Piezas de repuesto: Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que las piezas de repuesto especificadas por el fabricante tengan las mismas características que las piezas originales. Los repuestos no autorizados pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

**15.14** Uso: El propósito de este monitor para bebés es servir como una ayuda. NO es un sustituto de la supervisión responsable y correcta de un adulto y no debe ser utilizado como tal. Use este aparato SOLO para los fines descritos en este manual.


**15.15 Fuentes de alimentación:** use este producto solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la placa de identificación del adaptador. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación eléctrica de su hogar, consulte a su distribuidor o a la empresa de energía eléctrica local.

**15.16 Sobrecarga.** NO sobrecargue los tomacorrientes, cables de extensión o receptáculos integrales, ya que esto puede ocasionar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

**15.17 Entrada de objetos y líquidos:** NUNCA introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o causar un cortocircuito que podría ocasionar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica. NUNCA derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

**15.18 Antena:** la antena utilizada para este transmisor debe instalarse a una distancia de al menos 20 cm (7,9") de todas las personas y no debe colocarse ni operar conjuntamente con otra antena o transmisor.

**15.19 Líneas de energía eléctrica:** un sistema de antena exterior NO debería estar situado en las proximidades de líneas eléctricas aéreas o de otro circuito de luz o potencia, o donde pueda caer sobre dichas líneas o circuitos ya que el contacto con ellos puede ser letal.



**15.20 ADVERTENCIA Peligro de estrangulación** — Ha habido casos de niños que se han ESTRANGULADO. Mantenga los cables de los adaptadores fuera

del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]). NUNCA use el detector de movimientos sin la cobertura de protección del cable. Verifique la cobertura de protección antes de cada uso. Si la cobertura de protección se encuentra dañada o rota, suspenda inmediatamente el uso del detector de movimientos.

**15.21 Interferencias:** Este monitor utiliza ondas públicas para transmitir señales. La unidad para los padres hasta puede captar señales o interferencias de otros monitores de bebés en su zona. Las señales de su monitor hasta pueden ser captadas en otras viviendas. Para proteger su esfera privada, asegúrese de que ambas unidades estén APAGADAS (OFF) cuando no se encuentran en uso. Si capta interferencias, cambie el canal de ambas unidades.

**15.22 Fuente de vibración:** cuando el monitor está en uso, NO utilice accesorios de cuna como móviles o de otro tipo que puedan producir vibraciones. Otras fuentes de vibración pueden incluir ventiladores, lavadoras, música alta, etc. Estas fuentes de vibración pueden interferir con el desempeño de su monitor Angelcare® y la alarma no sonará si continúa detectando cualquier otro movimiento que no sea el de su bebé. Antes de utilizar el monitor asegúrese de que se hayan eliminado todas las fuentes de vibración.

Pueden producirse falsas alarmas por varias razones. La razón más común es que la unidad del bebé no se haya apagado (posición OFF) después de haber retirado al bebé de la cuna. Otra razón es que el detector de movimientos no se haya puesto correctamente debajo del colchón.

Asegúrese de que el detector de movimientos esté en una superficie plana y firme con la cara impresa hacia arriba. También puede ser necesario ajustar el nivel de sensibilidad. Consulte el paso 5.1. Siempre que suene una alarma, asegúrese de ver de inmediato a su bebé.

**15.23 Detector de movimientos:** Si la cuna tiene una base de resortes o listones, coloque una tabla de fibra de alta densidad entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 33 x 33 cm (13" x 13") y tenga 6 mm (1/4") de espesor. Solo use el monitor Angelcare® en un ambiente fijo para dormir, como una cuna, donde el detector de movimientos pueda colocarse en una superficie completamente plana y firme.

## **16. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD SOBRE EL USO DE BATERÍAS**

**16.1** Utilice SOLO el tipo y el tamaño de baterías especificados en el manual del propietario. Si las baterías se reemplazan por un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.

**16.2** SOLO utilice baterías AAA recargables o los adaptadores de CA proporcionados para la unidad para los padres. En la unidad para los padres se deben utilizar solamente baterías recargables. NO utilice baterías alcalinas porque dañarían seriamente a la unidad.

**16.3** Cargue las baterías durante 15 horas antes de usar la unidad por primera vez. Asegúrese de que el monitor esté apagado (OFF) durante este período. Utilice SOLO los adaptadores de CA incluidos.

**16.4** NO use estos adaptadores con otros equipos.

**16.5** Al desenchufar el adaptador de CA de la unidad del bebé, asegúrese de que esté APAGADO (OFF). De lo contrario, la unidad volverá al modo de batería si las baterías están instaladas.

**16.6** NO utilice baterías recargables en la unidad del bebé. Use SOLO baterías alcalinas.

**16.7** NO arroje las baterías al fuego. Pueden explotar. Para obtener posibles instrucciones especiales sobre cómo eliminar las baterías, consulte las regulaciones locales.

**16.8** Tenga cuidado al manipular las baterías para no producir un cortocircuito con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves. Se deben evitar la sobrecarga, el cortocircuito, la carga a la inversa, la mutilación o la incineración de baterías para prevenir una o más de las siguientes situaciones: liberación de materiales tóxicos, liberación de hidrógeno o gas de oxígeno, aumento de la temperatura de la superficie.

**16.9** NO intente recargar las baterías suministradas o identificadas para su uso con este producto que no estén destinadas a ser cargadas. Las baterías pueden perder electrolitos corrosivos o explotar.

**16.10** NO intente rejuvenecer las baterías suministradas o identificadas para su uso con este producto, calentándolas. Puede producirse una liberación repentina de electrolitos de la batería y provocar quemaduras o irritación en los ojos o la piel.

**16.11** Cuando sea necesario, las baterías deben ser reemplazadas por unas nuevas e idénticas o equivalentes (voltios y tamaño). Si la batería por cambiar está conectada con otras baterías en serie, reemplace las otras baterías al mismo tiempo. NO mezcle baterías nuevas y antiguas.

**16.12** Debe evitarse la instalación de las baterías en el producto final con polaridad inversa. La instalación reversa de las baterías puede causar que se carguen, provocando así una fuga o una explosión.

**16.13** Si guarda el producto durante más de 30 días retire las baterías, ya que estas podrían tener fugas y dañar el producto.

**16.14** Elimine las baterías agotadas tan pronto como sea posible ya que estas son más propensas a filtrarse al producto. Si la batería se ha filtrado o está dañada, se debe reemplazar inmediatamente usando guantes protectores.

**16.15** NO guarde este producto o las baterías proporcionadas o identificadas para su uso en áreas de alta temperatura.



## **FC WARNING**

### **(Solo para Norteamérica)**

**17.1** Las modificaciones no consentidas por el fabricante pueden anular la autorización de los usuarios para utilizar este dispositivo.

**17.2 NOTA:** Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la licencia de Industry Canada excepto la(s) norma(s) RSS. El propósito de estos límites es brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se lo instala y emplea según las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

**17.3** Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión -lo que puede determinarse al apagar (posición OFF) y encender el equipo (posición ON)- se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

**17.4** Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC y la licencia de Industry Canada excepto la(s) norma(s) RSS. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- 2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**E  
S**

## **REGULACIONES DE FCC E IC**

### **Declaración sobre exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):**

La unidad del bebé cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) establecidos por la FCC para ambientes no controlados. **Precaución:** Para cumplir con las directrices de exposición a la radiofrecuencia definidas por la FCC, instale la unidad del bebé a una distancia de al menos 20 cm del bebé y de las personas cercanas. En caso de llevarla junto al cuerpo, esta unidad para los padres ha sido probada y cumple con las directrices de exposición a la radiofrecuencia estipuladas por la FCC. Utilice el equipo exclusivamente con el clip para cinturón suministrado. El uso de otros accesorios puede conllevar que el dispositivo deje de cumplir con las directrices de exposición a la radiofrecuencia de la FCC.

### **Industry Canada**

Este producto cumple con las especificaciones técnicas pertinentes de Industry Canada (IC). CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

## INCLUYE:



Unidad para los padres recargable




Unidad del bebé



Base de carga




Clip de cinturón

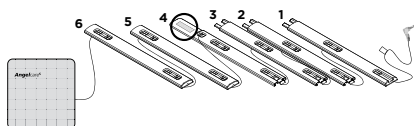

Detector de movimientos con protección de cables preinstalada



2 adaptadores de CA



2 baterías AAA recargables tipo AAA para la unidad de los padres

## USTED DEBE PREPARAR LO SIGUIENTE:

Una tabla de fibra de alta densidad (no se incluye). Espesor: **6 mm (1/4")**

Dimensiones mínimas:

**33 cm (13") x 33 cm (13")**

Dimensiones máximas:

el mismo tamaño que el colchón tabla de fibra de lata densidad



Tabla de fibra

### IMPORTANTE

La tabla de fibra de alta densidad debe ser más grande que el área de superficie del detector o los detectores de movimientos.

## NECESITARÁ LO SIGUIENTE (NO INCLUIDO):



2 baterías AA alcalinas para la unidad del bebé




Destornillador Phillips miniatura

## HABITACIÓN DEL BEBÉ:


### IMPORTANTE

Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo y lejos de corrientes de aire. Instale la unidad del bebé sobre una superficie plana y estable en dirección a la cuna a una distancia de al menos **0.9 metro (3 pies)**. Asegúrate de enchufar el adaptador al enchufe mas cercano al equipo para facilitar su accesibilidad.

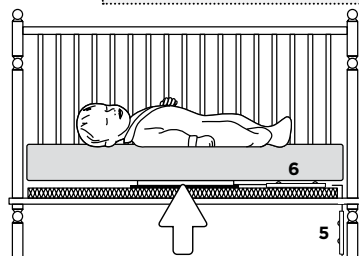


Detector de movimientos

**IMPORTANTE**  
Mantenga una distancia mínima de **0.9 m (3 pies)**.





## PASO 1 - CARGUE LA UNIDAD PARA LOS PADRES (10 HORAS)



### ADVERTENCIA

Nunca utilice baterías alcalinas comunes en la unidad para los padres; podrían explotar.




- 1) Deslice el botón para destrabar y abrir la tapa del compartimiento de la batería. Inserte las baterías recargables (incluidas) como se muestra en la imagen.
- 2) Conecte el adaptador de CA a la unidad para los padres y al tomacorriente.
- 3) Cargue la unidad durante **10 horas seguidas (antes de utilizarla por primera vez).**


### NOTA:

Para optimizar el rendimiento de la batería, consulte las directrices para baterías que figuran en la sección resolución de problemas.

## UNIDAD PARA LOS PADRES:

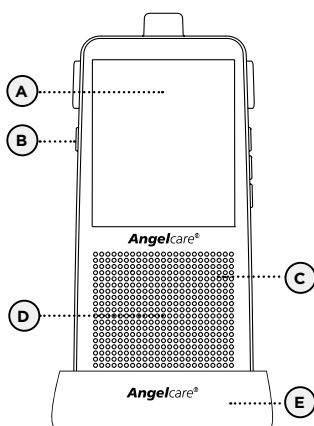


Vista frontal

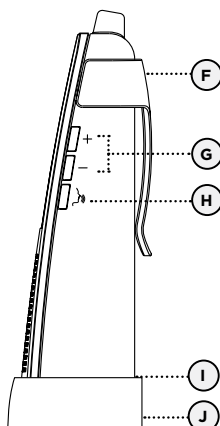

Vista del lado derecho

- A) Pantalla táctil LCD
- B) ENCENDIDO/APAGADO
- C) Micrófono
- D) Altavoz
- E) Base de carga
- F) Gancho de cinturón
- G) Botones de control de volumen del altavoz
- H) Botón de comunicación bidireccional y selección de temperatura °C/°F.
- I) Tapa del compartimiento de la batería (no se muestra)
- J) Boca del adaptador de CA (no se muestra)

## PASO 2 - INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS

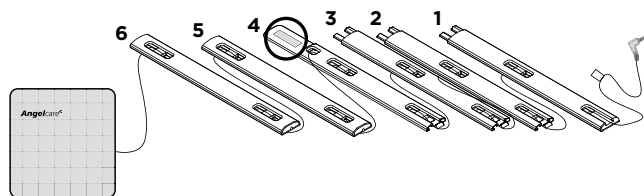

Detector de movimientos con protección de cables preinstalada

### Protección de cables

#### 1,2,3,4:

Posición en el suelo

#### Protección de cables 4:

Contiene cinta adhesiva de doble cara para instalarlo debajo de la pata de la cuna

#### Protección de cables 5:

Para ponerla verticalmente entre soporte del colchón y el suelo

#### Protección de cables 6:

Ponerla por debajo del colchón

## ⚠ ADVERTENCIA




### PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.

Algunos niños se han ESTRANGULADO con los cables.

- Mantenga los cables de los adaptadores fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]).
- Debido al grave riesgo de estrangulación para los bebés y niños pequeños, los padres y los cuidadores nunca deben colocar la unidad del bebé a una distancia menor de 0.9 metro (3 pies) de la cuna.
- **NUNCA** utilice el detector de movimientos sin tapa protectora del cable. Revise las tapas protectoras de los cables antes de cada uso y verifique que está sujetado de modo seguro por debajo de una de las patas de la cuna. Discutinire el uso del detector de movimientos si la tapa está dañada o rota.
- **NUNCA** utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice **SOLAMENTE** los adaptadores de CA suministrados. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

### 2.1 - SELECCIONE EL SITIO PARA LA UNIDAD DE BEBÉ

Seleccione el sitio para la unidad de bebé que debe estar por lo menos **3 pies (0.9 metro)** apartado de la cuna.

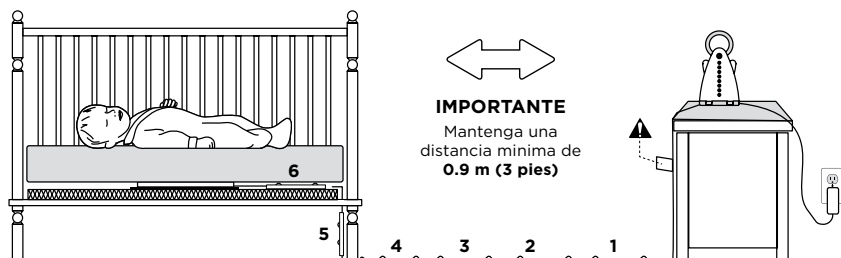

#### IMPORTANTE

Mantenga una distancia mínima de 0.9 m (3 pies)

## 2.2 SELECCIONE LA PATA DE LA CUNA QUE QUIERE USAR PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE CABLES

### RECOMENDADO

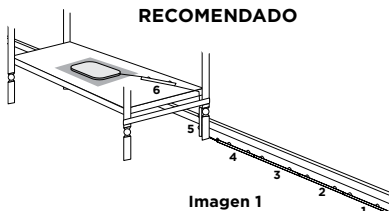


Imagen 1

O


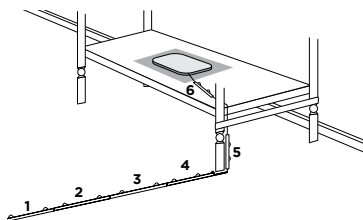



Imagen 2

- 1) Utilice la pata de la cuna al lado de la pared y más cerca a la unidad de bebé (**imagen 1**). Si la unidad de bebé está en el otro lado de la habitación, utilice la pata más cerca a la unidad de bebé para colocar el cable protegido (**imagen 2**). Es preferible que el cable protegido esté colocado a lo largo de una pared.


## 2.3 - INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS EN EL SOPORTE DEL COLCHÓN

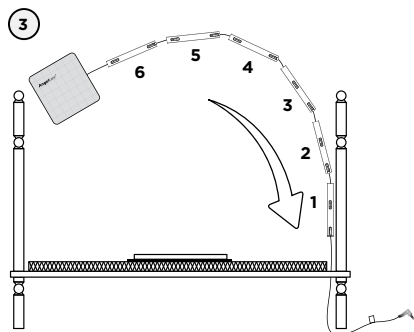


- 1) Retire el colchón de la cuna.
- 2) Coloque el detector de movimientos (con la cara impresa hacia arriba) sobre la **tabla de fibra de alta densidad**, en el medio de la cuna.
- 3) Lleve la pieza de conexión, la etiqueta de advertencia y las 5 primeras piezas de protección hacia abajo, a lo largo de la parte trasera de la pata de la cuna, **entre el soporte del colchón y el borde interior de la cuna**.

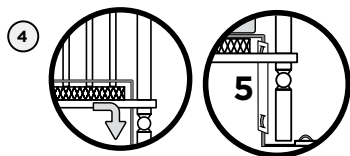


- 4) Lleve las 4 primeras piezas de protección de cable hacia el suelo y mantenga la quinta en posición vertical a lo largo de la parte trasera de la pata de la cuna (**entre el soporte del colchón y el borde interior de la cuna**).
- 5) Tire para entesar el cable y asegúrese que no haya partes flojas.



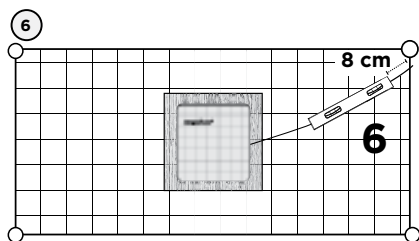

6) Coloque la sexta protección a una distancia de unos 8 cm (3 pulgadas) del borde del soporte del colchón.

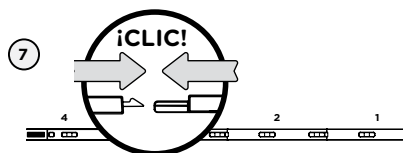

7) Junte las protecciones de cable restantes que estarán colocadas en el suelo.




8) Tire para entesar el cable y asegúrese que no haya partes flojas.

9) Remueva la protección de la cinta adhesiva de doble cara en la cuarta protección para el cable y colóquelo de forma segura por debajo de la pata de la cuna.

10) Instale la unidad del bebé sobre una superficie plana y estable en dirección a la cuna a una distancia de al menos 0.9 metro (3 pies) y conecte el detector de movimientos con la unidad de bebé.

11) Compruebe que el detector de movimientos no se ha movido de su posición inicial.

12) Vuelva a colocar el colchón en la cuna.



El detector de movimientos funciona con cualquier tamaño y tipo de colchón excepto los colchones con espuma viscoelástica y colchones con bastidores huecos.

La tabla de fibra de alta densidad mantiene una presión constante sobre el detector de movimientos, lo que permite detectar los movimientos del bebé aun cuando el bebé está en el borde de la cuna.


## ⚠ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN

- Tire para entesar el cable del detector de movimientos.
- Cuando el bebé crece y hay que bajar el soporte del colchón, deslice la protección vertical del cable (5) hacia arriba para que siga quedando en el centro entre el soporte del colchón y el suelo. Lleve el cable del detector de movimientos a través de la protección en el suelo y tire para que no haya parte flojas.
- El detector de movimientos no está diseñado para usarse con adultos, niños o lactantes de más de 24 meses.
- Discontinúe el uso del detector de movimientos si el niño tiene más de 24 meses. Retire el detector de movimientos de la cuna y guárdelo para usarlo en el futuro.
- ANTES DE USAR EL MONITOR POR PRIMERA VEZ: Para comprobar que el monitor esté preparado para ser utilizado, consulte el manual de instrucciones acerca del procedimiento adecuado.




## PASO 3 - INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DEL BEBÉ




- 1) Desenrosque la tapa del compartimiento de la batería e inserte 2 baterías AA alcalinas (no se incluyen).
- 2) Coloque la unidad del bebé a una **distancia mínima de 0.9 m (3 pies)** de la cuna.
- 3) Conecte el adaptador de CA a la unidad del bebé y al tomacorriente.

### NOTA:


Las baterías conservan la alimentación de energía en caso de corte de luz.



## UNIDAD DEL BEBÉ:

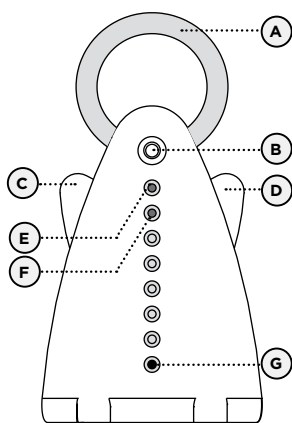


Vista frontal

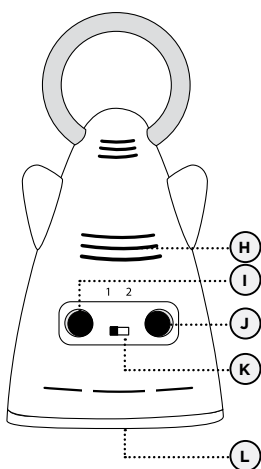

Vista posterior

- A) Lamparilla de noche
- B) Botón de pausa/localizador
- C) **ENCENDIDO/APAGADO** ("Ala" izquierda)
- D) **ENCENDIDO/APAGADO** de la lamparilla de noche ("Ala" derecha)
- E) Indicador de encendido (verde) Indicador para batería baja (rojo) Indicador de pausa (verde parpadeante)
- F) Indicador de movimientos (verde) Indicador de alarma (rojo)
- G) Micrófono
- H) Altavoz
- I) Salida del detector de movimientos
- J) Salida del adaptador de CA
- K) Interruptor de la unidad del bebé  
Modo 1 - Modo estándar  
Modo 2 - Solo movimientos
- L) Tapa del compartimiento de la batería (no se muestra)

## PASO 4 - ENCENDIDO DEL MONITOR

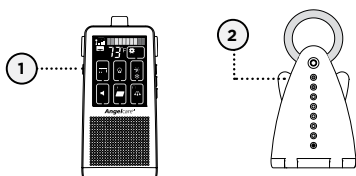


- 1) Pulse el botón de encendido/apagado **ON/OFF** de la unidad para los padres para activar y mostrar el modo normal.
- 2) Pulse el botón del **“ala”** izquierda de la unidad del bebé y manténgalo presionado durante 2 segundos.

El monitor LCD tiene 30 segundos de tiempo de espera para pasar al modo de ahorro de energía (iluminación más tenue). Pulse cualquier tecla para reactivarlo.



Cuando la unidad para los padres está encendida (**ON**) y la unidad del bebé está apagada (**OFF**), la unidad para los padres intenta conectarse con la unidad de bebé. El ícono de **Conexión** mostrará el siguiente ciclo.



Si se pierde la conexión entre las dos unidades (consulte la Pág. de Resolución de problemas):

- El ícono de **Fuera del alcance** aparecerá en la pantalla y la unidad para los padres emitirá un pitido.

## ÍCONOS IMPORTANTES



### Ícono de temperatura:

Indica la temperatura de la habitación.

### Ícono de nivel de batería:

Indica el nivel de batería.



Vacía



1/3 llena



2/3 llena



Llena



**Íconos de configuración:** Acceso a la configuración



**Ícono de VOX:** Indica que la función Vox está activada (activado por la voz).



**Ícono de ECO:** Indica que la función ECO está activada.



### Temperatura

**Ícono de la alarma:** Indica que la alarma de temperatura está activada.



**Ícono de sonido:** Indica que el sonido está activado.



### Ícono del detector de movimientos:

Indica que el detector de movimientos está activado.



**Ícono de péndulo:** Indica que la función 'TIC' está activada.



**Barra de nivel:** Indica el nivel de sonido de la unidad del bebé.

**Ícono de conexión:** Indica la calidad de la conexión entre la unidad para los padres y la unidad del bebé.



Conexión buena



Conexión regular



Conexión mala




Fuera del alcance



## PASO 5 - PRUEBA Y CONOCIMIENTO DEL MONITOR

El monitor Angelcare® se puede utilizar con las configuraciones preprogramadas de fábrica o puede personalizar las configuraciones según su preferencia.



**NOTA:** Ninguno de los cambios y ajustes que se efectúen en el modo de **Configuración** se activará a menos que los confirme pulsando el icono **Return** (regresar). Se emitirá un pitido largo que confirmará su modificación.

### IMPORTANTE

En el modo de **Configuración**, se desactiva transitoriamente la transmisión de sonido entre la unidad para los padres y la unidad del bebé. **SOLO** permanecerá activa la alarma de movimiento (cuando la función ya estaba activada).

## 5.1 - DETECTOR DE MOVIMIENTOS

PARA ACTIVAR EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS:



- 1) Pulse el icono del **detector de movimientos** para **activar o desactivar** el modo de movimiento.




ACTIVADO  
(ON)



DESACTIVADO  
(OFF)

Cuando el modo de **movimiento** está desactivado (**OFF**), el modo **'TIC'** se establece automáticamente a desactivado (**OFF**). Esto le permitirá detectar **SOLAMENTE los sonidos que emita el bebé**.

PARA PROBAR EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS:

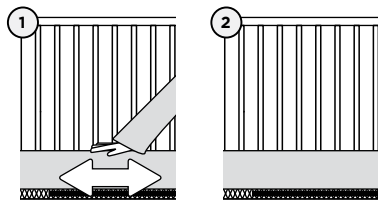

- 1) Mueva la mano despacio sobre el colchón.
- 2) Retire la mano del colchón. Después de 15 segundos, escuchará un sonido de prealarma **"TIC"** y, 5 segundos después, se activará la **alarma de movimiento**.
- 3) Repita la acción pasando la mano suavemente por las cuatro esquinas del colchón. Verifique que el **indicador de movimiento de la unidad del bebé** siga parpadeando.




### ALARMA DE MOVIMIENTO

- La alarma se activa cuando el detector de movimientos no detecta ningún movimiento durante 20 segundos.
- Los altavoces de la unidad para los padres y de la unidad del bebé emitirán un fuerte sonido de advertencia.
- El icono de la **alarma de movimiento** aparecerá en la pantalla LCD.

### SI LA ALARMA NO SUENA

- Evite el contacto con la cuna cuando el detector de movimientos está en funcionamiento.
- Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo.
- Ajuste el nivel de sensibilidad del detector de movimientos.

## SUSPENSIÓN DE LA ALARMA




Pulse cualquier botón de la unidad para los padres para **Pausar** la unidad (vea el **Paso 6.5**).

Vuelva a colocar la mano en el colchón.





Pulse el botón de **Pausa** de la unidad del bebé (vea el **Paso 6.5**).

Mantenga presionado el botón del "ala" izquierda durante dos segundos para apagar la unidad.



## PARA AJUSTAR EL NIVEL DE SENSIBILIDAD DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS:



Nivel 1 L1  
Nivel 2 L2  
Nivel 3 L3  
Nivel 4 L4  
Nivel 5 L5

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de **configuración**.
- 2) Pulse el ícono de **sensibilidad de movimiento**.  
El ícono parpadeará.
- 3) Para seleccionar el nivel de sensibilidad deseado (de 1 a 5), use los botones (+) o (-) que se encuentran a la derecha de la unidad de los padres. **L1** es el nivel menos sensible y **L5** es el mas sensible.

- 4) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y regresar a la pantalla normal.

### NOTA:

Si recibe falsas alarmas, disminuya el nivel de sensibilidad.

### NOTA:

Si permanece en el modo de **configuración** y no efectúa ningún ajuste en un lapso de 30 segundos, la unidad regresará al modo normal sin que se registre actualización alguna.

## PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN "TIC":

Esta función le permite escuchar un sonido "TIC" cada vez que el bebé emita algún sonido (cuando esté activada - **ON** - la detección de sonidos).



### NOTA:

Cuando el modo de movimiento está desactivado (**OFF**), el modo 'TIC' se establece automáticamente en desactivado (**OFF**).

- 1) Pulse el ícono de **TIC** para **activar** o **desactivar** la función de sonido "TIC".



ACTIVADO  
(ON)



DESACTIVADO  
(OFF)

Si el ícono de **TIC** está activado, la unidad para los padres emitirá periódicamente un sonido **TIC**.

## IMPORTANTE

- El detector de movimientos no está diseñado para usarse con adultos, niños o lactantes de más de 24 meses.
- Cuando haya terminado de usar el detector de movimientos, retírelo de la cuna del bebé y guárdelo en otro lugar.


## 5.2 - SONIDO

### PARA AJUSTAR EL SONIDO:

Pulse los botones (+) o (-) para ajustar el nivel de volumen.

#### NOTA:


Al nivel **L0** la barra de nivel aún aparecerá en la pantalla y el ícono parpadeará. Si pulsa nuevamente el ícono parpadearante de **sonido**, automáticamente se activará la función silencio. La barra desaparecerá, y aparecerá una cruz en la pantalla de íconos. Para DESACTIVARLA, pulsa nuevamente el ícono de sonido. (Para obtener más información sobre el modo de silencio consulte el paso 6.6).



Suba el nivel de volumen (+).  
Baje el nivel de volumen (-).


Nivel 0	L0
Nivel 1	L1
Nivel 2	L2
Nivel 3	L3
Nivel 4	L4
Nivel 5	L5

### PARA BAJAR EL NIVEL DE VOLUMEN A L0



Pulse el botón (-) para seleccionar el nivel **L0** (vea el Paso 6.6).

### SELECCIONE EL MODO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL



Mantenga presionado el botón de **comunicación** bidireccional para hablarle a su bebé.

### PARA PROBAR EL SONIDO:

Pídale a alguien que hable hacia la unidad del bebé o coloque la unidad cerca de un radio para asegurarse de que recibe sonido.

#### IMPORTANTE

Para evitar el acople (silbido), mantenga ambas unidades a una distancia mínima de 3 m (10 pies).

### SI NO ESCUCHA SONIDO ALGUNO:

- Verifique que ambas unidades estén encendidas.
- Verifique que ambas unidades estén enchufadas a un tomacorriente que funcione correctamente.
- Revise las baterías de ambas unidades (reemplácelas o recárguelas según se requiera en cada unidad).
- Acerque la unidad para los padres a la unidad del bebé.

## 5.3 - BATERÍAS

### CÓMO REVISAR LAS BATERÍAS:

Desenchufe los adaptadores de CA de ambas unidades.

- Si no se muestra la luz verde en la unidad del bebé, reemplace las baterías.
- Si no se ilumina la unidad para los padres ni la pantalla, vuelva a cargar las baterías.

### CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES:

Coloque la unidad para los padres en el cargador para cargar completamente la unidad. Si bien las baterías con una capacidad de 1/3 funcionan normalmente, recomendamos que las recargue por completo.



1/3 llena 2/3 llena llenal



### ALARMA DE BATERÍA DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES

- La alarma se activa cuando las baterías deben recargarse.
- La unidad para los padres emitirá un pitido cada 20 segundos.
- El ícono de **batería de la pantalla** de la unidad para los padres parpadeará.

# AHORA PUEDE UTILIZAR SU MONITOR

El monitor Angelcare® se puede utilizar con las configuraciones preprogramadas de fábrica o puede personalizar las configuraciones según su preferencia.

## CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS



**Modo sonido:** ACTIVADO (ON)  
**Botones de control de volumen del altavoz:**  
Nivel 3 (de 5)



**Modo de movimiento:** ACTIVADO (ON)  
**Sensibilidad del detector de movimientos:**  
Nivel 3 (de 5)  
**SONIDO TIC:** DESACTIVADO (OFF)



**Alarma de temperatura:** DESACTIVADO (OFF)  
**Configuración de la alarma de temperatura:**  
Alarma de alta temperatura\*: 30°C / 86°F  
Alarma de baja temperatura\*: 19°C / 66°F

**VOX**

**Modo VOX:** DESACTIVADO (OFF)  
**Nivel de VOX:** Nivel 2 (de 4)


**ECO**

**Modo ECO:** DESACTIVADO (OFF)



**Modo Alarma:** Alarma con sonido solamente

\* Los valores preestablecidos para máxima/  
mínima temperatura pueden diferir en  
varios países.

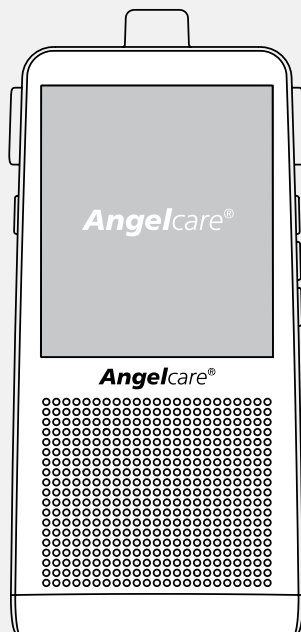

### NOTA:




Al realizar el procedimiento de reconexión usted restablecerá el sistema de supervisión a su configuración original predeterminada.

### IMPORTANTE

- Pruebe el monitor antes de usarlo por primera vez.
- Pruebe periódicamente el monitor para asegurarse de que funciona correctamente.
- Pruebe el monitor cada vez que coloque el detector de movimientos en un lugar diferente.

## MULTIFUNCIONAL

El monitor Angelcare® es multifuncional. Puede usarse en diferentes combinaciones según sus necesidades.



### SONIDOS Y MOVIMIENTOS:


Le permite detectar **LOS MOVIMIENTOS Y LOS SONIDOS** del bebé al combinar la unidad para los padres y el detector de movimientos.



Mueva el interruptor de conexión de la unidad del bebé a la posición **1** para detectar sonidos y movimientos.

### SOLO MOVIMIENTOS:

Le permite detectar **SOLO LOS MOVIMIENTOS** del bebé sin usar la unidad para los padres. Esta combinación puede ser útil cuando el bebé se encuentra en la misma habitación que los padres.



Mueva el interruptor de conexión de la unidad del bebé a la posición **2** para detectar **SOLO MOVIMIENTOS**. Si la unidad para los padres está encendida, solo mostrará el icono de **fuera del alcance**.

### SOLO SONIDOS:

Le permite detectar **SOLO LOS SONIDOS** del bebé sin usar el detector de movimientos. Esta combinación puede ser útil si no desea usar el detector de movimientos o si el bebé tiene más de 24 meses (la edad máxima para usar el detector de movimientos).




Mueva el interruptor de conexión de la unidad del bebé a la posición **2** para detectar **SOLO SONIDOS** (es necesario desactivar la función del detector de movimientos en la unidad para los padres y luego desconectarla de la unidad del bebé).

#### NOTA:

Para guardar el producto de modo seguro, simplemente retire el detector de movimientos y los cables de la cuna: desconecte el enchufe del cable del detector de la unidad del bebé y guárdelo de modo seguro dentro de una caja en otro lugar para usarlo en el futuro.

El monitor Angelcare® se puede utilizar con las configuraciones preprogramadas de fábrica o puede personalizar las configuraciones según su preferencia.



**NOTA:** Ninguno de los cambios y ajustes que se efectúen en el modo de **configuración** se activará a menos que los confirme pulsando el icono **Return** (regresar). Se emitirá un pitido largo que confirmará su modificación.

#### IMPORTANTE

En el modo de **configuración**, se desactiva transitoriamente la transmisión de sonido entre la unidad para los padres y la unidad del bebé. **SOLO** permanecerá activa la alarma de movimiento (cuando la función ya estaba activada).

## 6.1 - ACTIVACIÓN DE VOZ (VOX) O MODO DE SONIDO CONTINUO

Le permite seleccionar la forma de monitorear el sonido:

**VOX** (la activación de voz capta el sonido según el nivel de sensibilidad programado) o **continuo** (el monitoreo de sonido permanece activado, captando todos los sonidos).



- 1) Pulse el ícono de **VOX** para **activar** o **desactivar** a función **VOX**.





### NOTA:


Al desactivar el modo VOX, se activa la configuración de sonido continuo.

### PARA AJUSTAR LA SENSIBILIDAD DE VOX:

Le permite establecer el nivel de sonido necesario para activar la transmisión de sonido a la unidad para los padres.

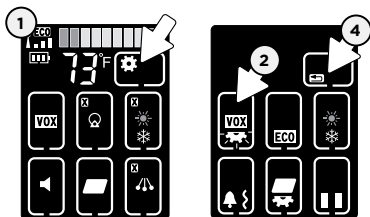

Nivel 1	L1
Nivel 2	L2
Nivel 3	L3
Nivel 4	L4

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de **configuración**.
- 2) Pulse el ícono de sensibilidad de **VOX**.  
 El icono parpadeará.
- 3) Use los botones (+) o (-) que se encuentran en el lado derecho de la unidad para los padres para seleccionar el nivel de sensibilidad deseado (de 1 a 4).

**O**

Pulse el ícono de **sensibilidad de voz** para seleccionar el nivel deseado.

- 4) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y volver a la pantalla normal


### NOTE:

En mode **ECO**, le réglage **VOX** est automatiquement activé.

## 6.2 - MODO ECO

Le permite bajar las emisiones electromagnéticas y prolongar la duración de la batería. Tenga en cuenta que, cuando esté en el modo **ECO**, se reducirá el alcance.

### PARA ACTIVAR EL MODO ECO:

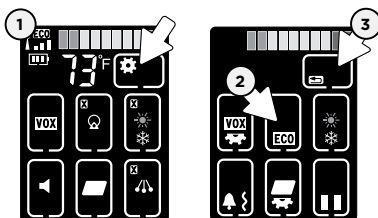

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de configuración.
- 2) Pulse el ícono de **ECO** para **activar** o **desactivar** la función **ECO**.




- 3) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y volver a la pantalla normal.



El ícono de **ECO** aparecerá junto al ícono de conexión cuando la función ya estaba activada.

## 6.3 - CONTROL DE TEMPERATURA

### PARA CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA:

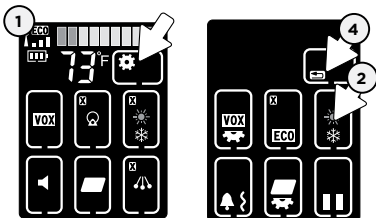

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de **configuración**.
- 2) Pulse el ícono de **configuración de temperatura**.
- 3) Pulse el **botón para hablar** en la unidad para los padres para cambiar de grados **Celsius** a **Fahrenheit**.



Celsius



Fahrenheit

- 4) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y volver a la pantalla normal.

### PARA ACTIVAR LA ALARMA DE TEMPERATURA:



- 1) Pulse el ícono de la **alarma de temperatura** para **activar** o **desactivar** la alarma de temperatura alta y baja.




ACTIVADO  
(ON)



DESACTIVADO  
(OFF)

### PARA CONFIGURAR EL RANGO DE TEMPERATURA:

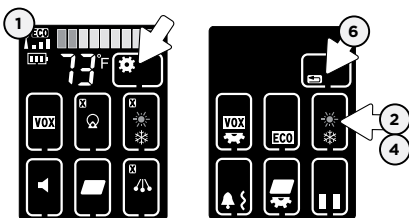

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de configuración.
- 2) Pulse el ícono de **alarma de temperatura**.
- 3) Parpadeará el ícono de **alta temperatura** (SOL); pulse los botones (+) o (-) para configurar la **alarma de alta temperatura** (de 22 a 35 °C/de 72 a 95 °F).
- 4) Pulse nuevamente el ícono de **alarma de temperatura**.
- 5) Parpadeará el ícono de **baja temperatura** (COPO DE NIEVE); pulse los botones (+) o (-) para configurar la alarma de baja temperatura (de 5 a 19 °C/de 41 a 66 °F).
- 6) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y volver a la pantalla normal.



Alta  
temperatura



Baja  
temperatura


#### ALARMA DE TEMPERATURA

- La alarma se activa cuando la temperatura alcanza una temperatura establecida como máximo o mínimo.
- La unidad para los padres emitirá 3 pitidos consecutivos y/o vibrará cada 5 segundos, según el tipo de alarma que haya seleccionado.
- El ícono de alarma aparecerá en la pantalla LCD y el ícono de **alta/baja** temperatura parpadeará.



## 6.4 - ALARMA

Le permite seleccionar su modo de alarma preferido para la unidad de los padres.

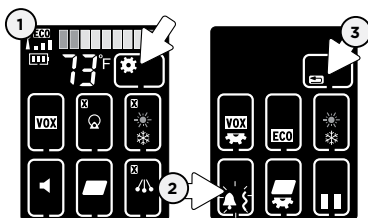

Alarma con sonido solamente



Alarma con sonido y vibración



Solo vibración:

Cuando se active la alarma de movimiento, la unidad para los padres vibrará y se escuchará una alarma con sonido en la unidad del bebé.

- 1) Pulse el ícono de **configuración** para acceder al modo de configuración.
- 2) Pulse el ícono de **alarma**; parpadeará el ícono del modo de **alarma** que esté programado en ese momento. Después, vuelva a pulsarlo para seleccionar el modo de alarma cuando la pantalla cambie a varios modos.
- 3) Pulse el ícono **Return** (regresar) para confirmar su selección y volver a la pantalla normal.



Cuando la unidad para los padres esté en el cargador, la alarma con sonido reemplazará el modo de **vibración**.

### IMPORTANTE

En el modo de **configuración**, no se transmite ningún sonido o alarma a la unidad para los padres, a excepción de la **alarma de movimiento** (si esta función ya estaba activada).

## 6.5 - PAUSA

Le permite poner el monitor Angelcare en **PAUSA**.

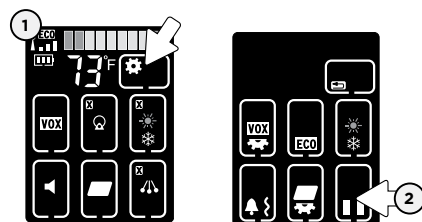

### NOTA:

En el modo **PAUSA**, la luz de encendido de la unidad del bebé parpadeará. La unidad para los padres emitirá pitidos y/o vibrará cada 20 segundos para recordarle que el monitor está en pausa, según el tipo de alarma seleccionado.

### IMPORTANTE

Cuando el monitor está en **Pausa**, se desactivan la función de movimiento y la alarma de movimiento.



## 6.6 - SILENCIO


Le permite activar la función **SILENCIO**.

### PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN SILENCIO:

Presione el ícono de sonido.

### PARA DESACTIVAR LA FUNCIÓN SILENCIO:

Pulse el ícono de sonido para desactivar la función.



ACTIVADO  
(ON)



DESACTIVADO  
(OFF)

### NOTA:



En la unidad para los padres, parpadeará el ícono de **SILENCIO**.

## 6.7 - LAMPARILLA DE NOCHE

Le permite utilizar el monitor como lamparilla de noche.

### PARA ACTIVAR LA LAMPARILLA:

Presione el “**ala**” derecha de la unidad del bebé o presione el ícono de **lamparilla de noche** de la unidad para los padres para seleccionar el nivel de luz



### NOTA:

Si la unidad del bebé está en modo de batería, la función de la **lamparilla de noche** se desactivará.



DESACTIVADO  
(OFF)



Tenue



Intensa

## 6.8 - LOCALIZADOR

Le permite localizar la unidad para los padres.

### PARA LOCALIZAR LA UNIDAD PARA LOS PADRES:

Presione y suelte el botón del **localizador** de la unidad del bebé. Durante un minuto la unidad para los padres emitirá un sonido de localización.



### PARA DETENER EL SONIDO DE LOCALIZACIÓN:



Pulse la **pantalla** o cualquier botón de la unidad para los padres



pulse el botón del **localizador** de la unidad del bebé




## CUIDADO DE LAS BATERÍAS RECARGABLES

- Asegúrese de cargar completamente las baterías durante 10 horas antes de usar la unidad por primera vez.
- Para mantener la máxima duración de la batería es conveniente descargarla completamente en forma periódica. Si se deja la batería constantemente cargándose en el cargador, se puede reducir su rendimiento. Si la unidad para los padres no está en uso, **apáguela**.
- Una potencia inadecuada de la batería puede perjudicar el desempeño del monitor. Si no está satisfecho con el desempeño de la unidad para los padres o del monitor, reemplace las baterías recargables (2 baterías recargables Ni-MH).
- Es aconsejable cambiar las baterías cada 6 meses.

## PÉRDIDA DE CONEXIÓN

En caso de pérdida de conexión, el primer paso para restablecerla es acercar la unidad para los padres a la unidad del bebé y verificar que ambas unidades estén encendidas (**ON**). Si después de realizar estas verificaciones y correcciones la falta de conexión persiste sin que se registre una alarma de **Fuera del alcance**, solo entonces se debe seguir el procedimiento de reconexión que se describe a continuación.

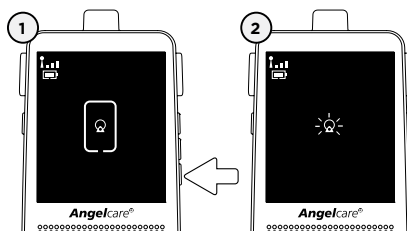

### Procedimiento de reconexión:


- 1) **Encienda** la unidad para los padres y mantenga presionado el botón para **hablar** durante 2 segundos hasta que aparezca el ícono de la **unidad del bebé** en el centro de la pantalla.
- 2) Al pulsar el botón del ícono de la **unidad del bebé**, la unidad para los padres se establecerá en el modo (el ícono **parpadeará**).

Después de 1 minuto sin funcionar, la unidad para los padres abandonará el modo de **conectividad** y usted tendrá que volver a comenzar el proceso.

- 3) Pulse el botón de **encendido** para encender la unidad del bebé. Se iluminará el diodo (LED) de encendido.
- 4) Luego pulse el botón de **encendido** 4 veces en un lapso de 30 segundos. Se iluminará el LED de **encendido**. El procedimiento de conexión se completará en unos 10 segundos.
- 5) Cuando la unidad para los padres y la unidad del bebé estén conectadas, la unidad para los padres mostrará **H1** (o **H2**) y luego pasará a la pantalla de modo de funcionamiento.


### NOTA:

Al realizar el procedimiento de reconexión usted restablecerá el sistema de supervisión a su configuración original predeterminada.

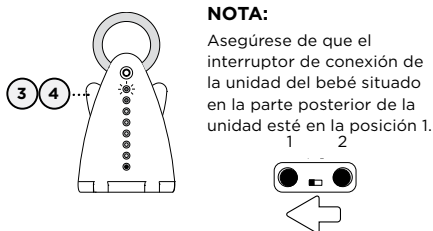

### NOTA:

Asegúrese de que el interruptor de conexión de la unidad del bebé situado en la parte posterior de la unidad esté en la posición 1.

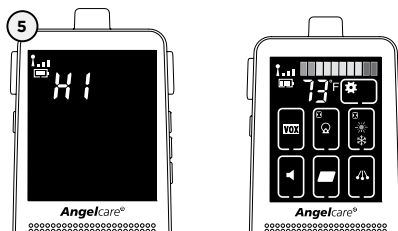

## FALSAS ALARMAS

- **Apague** la unidad del bebé.
- Verifique la conexión entre el detector de movimientos y la unidad del bebé. Desenchufe y vuelva a conectar el cable.
- Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y el detector de movimientos.
- Si la cuna tiene una base de resorte o listones, coloque una tabla de fibra de alta densidad entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 33 x 33 cm (13"x 13") y 6 mm (1/4") de espesor.
- Asegúrese de que el detector de movimientos se encuentre como se describe en los requisitos para la instalación. Es posible que se necesite ajustar el nivel de sensibilidad del detector de movimientos, consulte el **Paso 5.1**.

## LA ALARMA NO SUENA

- Evite el contacto con la cuna cuando el monitor está **encendido**.
- Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo firme para evitar que el detector de movimientos detecte un movimiento que no provenga de la cuna.
- Es posible que necesite disminuir la sensibilidad, consulte el **Paso 5.1**.
- **Apague** el móvil de cuna, ventiladores, música fuerte o cualquier otra cosa que pudiera producir vibraciones.

## NO SE TRANSMITE NINGÚN SONIDO

- Verifique que ambas unidades estén encendidas (**ON**).
- Si alguna de las unidades no recibe alimentación eléctrica, revise/reemplace las baterías, recargue la unidad para los padres y verifique que funcionen los adaptadores de CA. Si es necesario, cambie los tomacorrientes.
- Observe la pantalla de la unidad para los padres para ver si el monitor está en modo de **SILENCIO** en lugar de en modo encendido (**ON**). Consulte el **Paso 6.6** y aumente el nivel de volumen.
- Acerque la unidad para los padres a la unidad del bebé.

## EL INDICADOR DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD DEL BEBÉ (LUZ VERDE) NO SE ILUMINA

- Revise las conexiones o utilice otro tomacorriente.
- Mantenga presionada el "ala" izquierda durante 2 segundos para encender la unidad del bebé.

## RECEPCIÓN DÉBIL

- Acorte la distancia entre ambas unidades.
- Cambie la posición de una o de ambas unidades.
- Coloque las unidades en una superficie plana lejos del alcance del bebé.
- Reemplace las baterías o recargue la unidad para los padres.

## ESTÁTICA, DISTORSIÓN, INTERFERENCIAS ((DE OTROS MONITORES, TELÉFONOS INALÁMBRICOS, RADIOTRANSMISORES PORTÁTILES, ETC...))

- Gire la unidad para los padres o aléjela de la fuente de interferencia.

## ACOPLE (RUIDOS FUERTES EMITIDOS POR LA UNIDAD PARA LOS PADRES)

- Aleje las unidades (colóquelas al menos a 3 metros [10 pies] de distancia).
- Baje el volumen en la unidad para los padres.

## LA PANTALLA DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES ESTÁ EN NEGRO (UNIDAD PARA LOS PADRES APAGADA)

- Encienda la unidad para los padres nuevamente manteniendo presionado el botón de encendido.
- Reemplace las baterías o recargue la unidad para los padres.

## GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que el MONITOR DE MOVIMIENTOS Y SONIDOS CON PANTALLA TACTIL Angelcare® (modelo AC701) no contiene defectos en los materiales ni en el proceso de fabricación durante un (1) año (no se incluyen baterías recargables) a partir de la fecha de compra original. Si este sistema de supervisión no funciona correctamente cuando se utiliza según las instrucciones en condiciones normales dentro del período de un año, Angelcare® reparará o reemplazará el producto, a nuestra discreción, en forma gratuita. Comuníquese con su distribuidor.

El producto debe estar acompañado del comprobante de compra, ya sea una factura de venta o cualquier comprobante que demuestre que el sistema de supervisión se encuentra en el período de garantía. Angelcare® se hará cargo del costo de la reparación o del reemplazo del producto, y del envío de regreso a usted.

**Esta garantía no se aplica a productos dañados como resultado del mantenimiento incorrecto, de un accidente, de voltaje de alimentación incorrecto o de otra forma de uso indebido. Asimismo, la garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto de cualquier manera. Angelcare® no es responsable de los daños incidentales o emergentes relacionados con este producto. La garantía también excluye toda responsabilidad que no se mencione anteriormente. No se otorga ninguna otra garantía.**

Esta garantía no cubre productos ni accesorios que no sean de marca Angelcare®, ni problemas derivados de un uso no acorde a las instrucciones del producto, del incumplimiento de las instrucciones del producto, o de problemas causados por el uso de accesorio, piezas o componentes no suministrados por Angelcare®.

LOS DERECHOS LEGALES VARÍAN DE PAÍS EN PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A USTED.

NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

## IMPORTANTE!

Este monitor Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelva el producto a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a su distribuidor antes de regresar el producto.

### REGISTRAR PRODUCTOS ANGELCARE

Registre su monitor Angelcare® y demás productos Angelcare® en nuestro sitio web:  
**[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)**

ANGELCARE MONITORS INC.  
9975, avenue De Catania, Local B  
Brossard, Québec, Canada  
J4Z 3V6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Rango:

Alcance: Campo abierto (zona abierta sin obstáculos): hasta 250 metros (820 pies).

### Fuente de alimentación:

2 baterías AA alcalinas (no se incluyen) o un adaptador de 100-240V CA/5VCC para la unidad del bebé.

2 baterías AAA recargables y un adaptador de CA de 100-240V CA/5VCC para el cargador de la unidad para los padres.

**Precaución:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia ni a humedad.

Si las baterías se reemplazan incorrectamente, existe riesgo de explosión. Se incluyen las siguientes baterías: 2 baterías AAA recargables Ni-MH, fabricadas por GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) o por HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh).

**Solo se pueden reemplazar por 2 baterías AAA recargables Ni-MH.**

### Baterías:

- NO mezcle las baterías usadas con las nuevas.
- NO mezcle las baterías alcalinas estándar (zinc-carbono) o recargables (Ni-CD, Ni-MH, etc.).

### Transmisión:

La transmisión de datos entre la unidad para los padres y la unidad del bebé se produce a una frecuencia de entre 1880 y 1920 MHz (la banda de frecuencias exacta varía según el país).

Por este medio, Angelcare Monitors Inc, declara que este monitor para bebés cumple con los requisitos básicos y con otras disposiciones pertinentes de la Directriz

1999/5/EC. Puede solicitar la Declaración de conformidad de la Unión Europea a su distribuidor local. Consulte la dirección en el manual.



### PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE

Este equipo electrónico contiene material reutilizable y no se debe desechar junto a los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos (pida más información a las autoridades locales).

### CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA ERP

SUDÁFRICA - BRASIL - ECUADOR - UNIÓN EUROPEA - REINO UNIDO

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare® - número de modelo: T05005V001/ T05005B001

ALEMANIA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare® - número de modelo: T05005F002

AUSTRALIA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare® - número de modelo: T05005S002

NORTEAMÉRICA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare® - número de modelo: T05005U002

[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)

